




取扱説明書

在宅介護用ベッド

ミオレットシリーズ

Miolet III

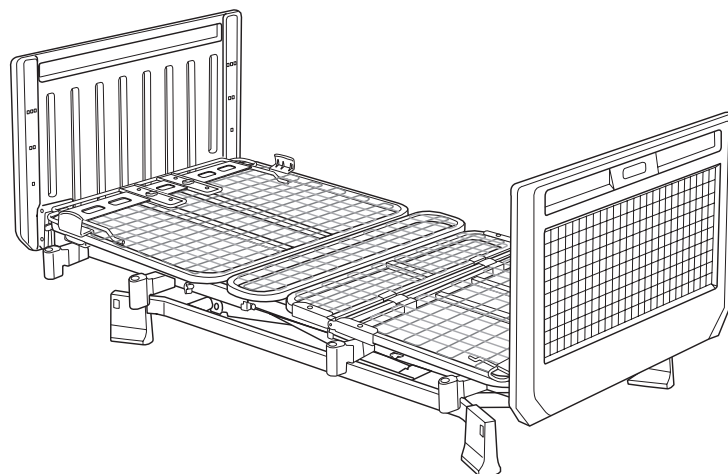

背上げ 1 モーターベッド

90 cm幅：P113-11 シリーズ
83 cm幅：P113-12 シリーズ

2 モーターベッド

90 cm幅：P113-21 シリーズ
83 cm幅：P113-22 シリーズ

3 モーターベッド

90 cm幅：P113-31 シリーズ
83 cm幅：P113-32 シリーズ

この度は在宅介護用ベッド「ミオレットⅢ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この「取扱説明書」は、組み立て・ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

〈保証書付〉

商品名
型 式



ミオレットⅢ
P113

株式会社 **プラッツ**

○このベッドはご家庭での介護を行うことを目的として作られたベッドです。このベッドには次のような特長があります。



背上げ

- 腰や首に痛みがあり、起き上がりが不安な方の起き上がりやすい姿勢を作ります。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

手元スイッチの使いかた
P28




ひざ上げ

- ひざ上げで、体に負担のかかりにくい姿勢を作ります。ひざ上げ時に“足先上げ”と“足先下げ”を選択できます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

便利な使いかた
P32



高さ調節

- 腰やひざに痛みがあり、立ち上がりが不安な方の立ち上がりやすい姿勢を作ります。
(背上げ 1 モーター除く)

2 モーター 3 モーター

手元スイッチの使いかた
P28



フィッティング機能

- ひざ位置のフィッティング機能で、身長に合わせた調節ができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

フィッティングバーの設定
P31

- 固定脚・キャスターの取り替えができます。
(キャスターはオプションです)

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

組み立てかた
P19

- 伝い歩きを考慮した形状のボードは取り外しができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

組み立てかた
P26

- 樹脂ボード内側の印に合わせて、背上げ角度の簡易確認ができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

便利な使いかた
P32

- 手元スイッチは、片手でも、レールに掛けたままでも操作がしやすい形状です。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

便利な使いかた
P32

- サイドレールホルダーは全て収納式です。車椅子からベッドへの移乗を楽に行うことができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

便利な使いかた
P32

- パーツの交換無しで、レギュラー・ショート・ロングタイプの切り替えができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

レギュラー/ショート/ロングの切り替え P29

- パーツ交換のみで、背上げ 1 モーター・2 モーター・3 モーターの変更ができます。

背1 モーター 2 モーター 3 モーター

変更のしかた
P34 ~ P36

■使用目的・特長	1
■もくじ	2
■安全にご使用いただくために(ご使用前・ご使用上の警告と注意)	3 ~ 11
■ベッドの設置と移動について	12 ~ 13
■各部の名称	14
■開梱と確認	15 ~ 18

■ベッドの組み立てかた	
・ベースフレームとセンターフレームの組み立て	19 ~ 21
・ヘッドフレーム、フットフレームの取り付け	22 ~ 24
・背ボトムの取り付け	24
・腰ボトム、ひざ脚ボトムの取り付け	25
・ヘッドボード、フットボードの取り付け	26

■コードの取り廻し	27
■手元スイッチの使いかた	◆背上げ 1 モーター 28
	◆ 2 モーター 28
	◆ 3 モーター 28
■レギュラー / ショート / ロングの切り替え	29
■ライジングモーション	◆目的 30
	◆「背あし連動」「背のみ」の切り替え 30
■フィッティングバーの設定	31
■便利な使いかた	32
■お手入れ・点検・マットレス・部品パックの取り付け	33
■変更のしかた	34 ~ 36

■仕様について	
・背上げ 1 モーターベッド (90 cm幅 / 83 cm幅)	37 ~ 38
・2 モーターベッド (90 cm幅 / 83 cm幅)	39 ~ 40
・3 モーターベッド (90 cm幅 / 83 cm幅)	41 ~ 42
■適合周辺機器	43 ~ 44
■パーツ組み合わせ	45 ~ 46
■レール類の組み合わせ	47 ~ 49
■停電時の背下げ方法	50
■故障について・保管について	51
■保証とアフターサービス	52

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。

警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重症を負う可能性が想定される内容を記載しています。

注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示



禁止

してはいけない「禁止」の内容です




気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です

！ご使用前の警告と注意



体位変換（寝返り等）の際に転落の危険性がありますので、マット面からレールの上まで 22 cm 以上を確保してください。マットレスは、P43～44「適合周辺機器」で詳細をご確認ください。

- ・不適合機器をご使用されますと、怪我や事故の原因になる恐れがあります。

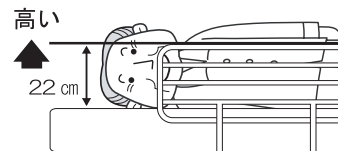

洪水や火災などで被災したベッドは電源プラグを抜き、使用前に販売店に点検を依頼してください。

- ・電気部品のショートなどは火災の原因となる恐れがあります。
- ・破損部品があると、思わぬ怪我をする恐れがあります。



サイドレールとベッド用グリップ、サイドレール、ベッド用グリップとボードやボトムなどとの隙間に身体の一部が入らないよう注意してください。

- ・隙間にはさまれたり、怪我や事故の恐れがあります。



禁止

このベッドは屋外では使用できません。


- ・濡れたまま使用されますと、火災や感電の原因になる恐れがあります。
- ・尿などの水分がモーター、手元スイッチにかかった場合は電源プラグを抜き、使用せずに販売店にご相談ください。



禁止

他社製のサイドレール、ベッド用グリップや、この取扱説明書で指定した周辺機器以外の組み合わせで使用しないでください。

- ・危険な隙間が発生し腕や首、頭をはさむなど重大事故の原因になる恐れがあります。

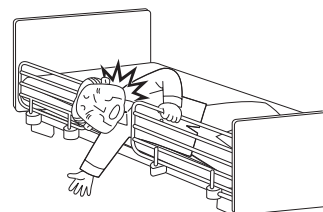

⚠️ ご使用前の警告と注意




禁止

キャスターを付けた場合、ロックを解除した状態で放置しないでください。

掃除の際など移動した後は必ずロックしてください。

- ・ベッドからの乗り降りの際、ベッドが移動し転倒の危険性があります。



キャスターは必ず固定



注

ご使用になられる前に、各部のピン、ボルトが確実に固定されているか、ご確認ください。


- ・ピンやボルトが緩んでいると、ご使用中にパーツが外れたりすること考えられ事故の原因になる恐れがあります。



注

治療中の方やペースメーカーご使用の方は医師に相談してください。

- ・ベッドの操作が、症状を悪化させる可能性があります。
- ・医師、看護師の指導に従ってください。
- ・背脚の角度によっては床ずれなどの症状を悪化させることがあります。

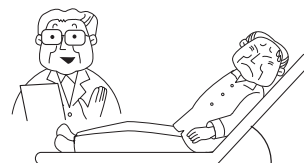

注

ベッドの周りに不要な物を置かないでください。

⚠️ ご使用上の警告と注意



注

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方がベッド操作をしてください。怪我や事故の原因となる恐れがあります。


- ・ご家族に小さなお子様がいる場合、ベッドを使用しない場合は電源プラグを抜いてください。ベッドで遊んで事故や怪我を起こす恐れがあります。



禁止

ベッドに立った状態で手元スイッチの操作をしないでください。


- ・転倒などにより怪我や事故の原因になる恐れがあります。

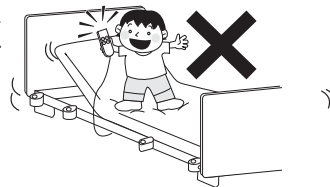

禁止

ベッドにうつ伏せで寝た状態や頭脚逆方向で寝た状態でご使用はしないでください。


- ・背骨を痛めるなど怪我や事故の原因になる恐れがあります。

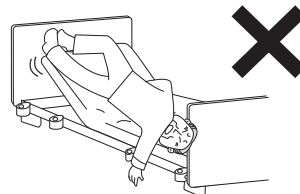

禁止

「上がっている背やひざ脚ボトムの上に乗る」「ボトムの上で飛び跳ねる」「ボトムに飛び乗る」などの行為はしないでください。

- ・怪我や事故、ベッド破損の原因になる恐れがあります。





⚠ ご使用上の警告と注意



禁止

モーターの長時間連続使用（2 分以上）はしないでください。


- ・内部の部品が破損したり、モーター内部が加熱し、温度ヒューズが破断したりして動かなくなる恐れがあります。
- ・動かなくなったら販売店にお問い合わせください。この場合は修理費が発生します。



禁止

サイドレール・ベッド用グリップを取り付けてご使用の際に、体の一部（頭、腕、脚）をサイドレール・ベッド用グリップの隙間に入れないでください。


- ・骨折など、怪我をする恐れがあります。安全に使用いただくために、安全カバーを別売りにてご用意しております。

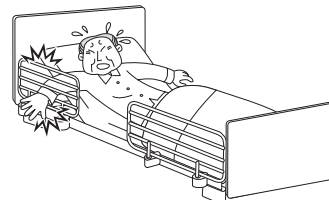

禁止

電源プラグは濡れた手で触らないでください。

- ・感電する恐れがあります。



介護者などがベッドから離れたり、ご利用者から一時的に目を離す際は、安全のためベッドの高さを最低位置にしてください。万一の転落の際にも、衝撃を軽減できます。



ベッドの中に他のケーブルを通す場合は、ベッドの部品間でケーブルを圧迫することの無いよう充分確認してください。



ベッド用グリップやハンドグリップ（P43～P44 参照）を使用される場合、ベッドにしっかりと固定されているか定期的に確認してください。


- ・転倒し怪我や骨折を起こす恐れがあります。



禁止

掃除、点検などでベッド下に入る場合は必ず電源プラグを抜いてください。

- ・誤操作によりベッドにはさまれ重傷事故の恐れがあります。

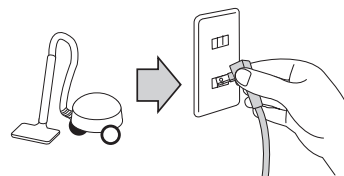

禁止

各部の操作をする場合、フレームとボトムの間を手や指を入れないでください。


- ・骨折など、怪我をする恐れがあります。



禁止

ベッドの下にもぐり込んだり、手や足を入れないでください。

- ・骨折など、怪我をする恐れがあります。



⚠ ご使用上の警告と注意




濡れた手で手元スイッチの操作をしないでください。水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないでください。

- ・ショートして故障、火災や感電の恐れがあります。
- ・誤作動の原因になる恐れがあります。




電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

- ・断線、接触不良により、火災の原因、故障の原因になる恐れがあります。



ボードとボトムの間に空間があります。
介護する場合に足が入ることがありますので
ご注意ください。



介護度が高い方や、背を上げた時に自分で体を保持できず体が斜めになる方の場合、ロングタイプのサイドレールかベッド用グリップを「レール類の組み合わせ」(P47～P49)の図のように組み合わせてください。背を上げると支えがなくなり、ベッドから転落する危険性があります。



手元スイッチを使用しない時は、安全な場所にフックで掛けてください。
・誤ったボタン操作をされますと、怪我や事故の恐れがあります。




ベッドの背上げや高さ調節などの操作をする時は、ベッドご利用者の状態に注意してください。
・ベッド操作中に、ご利用者が動くと怪我や事故の恐れがあります。
・自分で体位を保持できない方は、身体を支えながら操作してください。



禁止

フレームをつかんだ状態で背を下げないでください。
サイドレールやフレームの間に指をはさむ危険性があります。




禁止

本体に貼ってあるシールは、剥がさないでください。お客様を危険から守るためや故障時に素早い対応をするためのものです。
・ロット番号から詳細仕様が分かり、的確な対応が可能になります。



禁止

サイドレールの端に体重を掛けしないでください。
・傾いて転倒する恐れがあります。
・過度の荷重をかけると破損する可能性がありますので、立ち上がりに不安のある方は、このベッド指定の「ベッド用グリップやハンドグリップ (P43～P44 参照)」をご使用ください。



！ご使用上の警告と注意




ベッド用グリップのスイング部で、足など人体の一部をはさむ可能性がありますので、開閉時やベッドの乗り降りの際にはご注意ください。



禁止


このベッドは一人専用のベッドです。ベッドを二人以上でご使用にならないでください。
リハビリを行う際、ベッドに座る際、勢いをつけて過度に荷重をかけたりしないでください。



介護者の方へ


背ボトムを上げると寝ている人の背中全体に加圧（背圧）が生じ放置すると呼吸困難にもなります。これはどのベッドでも構造上避けることができない現象です。これを解消するために背上げが終わった時に、図のように背とマットの間に手を入れて背を起こし、背抜き（除圧）してあげてください。

- ・除圧しないと腰痛、床ずれが発生したり、場合により呼吸困難にもなります。

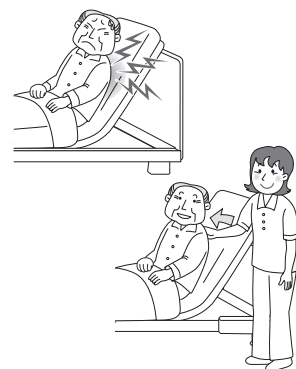


ベッドからの乗り降りの際の転倒事故が多発しています。必ず下記の事を守ってご使用ください。

- ・ベッド横から乗り降りしてください。
- ・サイドレールをまたいだり、ヘッドボードやフットボードをまたいだりしないでください。
- ・睡眠薬を服用の際は、医師から指示された時間内にベッドから立ち上がることはしないでください。
- ・車椅子への移乗の際は、ベッド、車椅子のキャスターがロックされているかを確認して、乗り降りしてください。

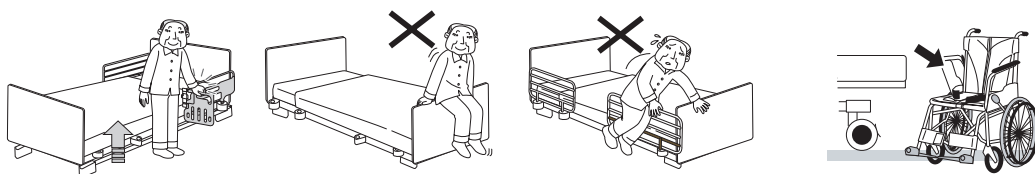

禁止

背ボトムを無理に内側に倒さないでください。
・故障の原因になります。

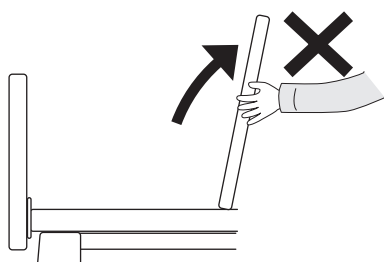


禁止

分解・改造はしないでください。
・故障や感電の原因になります。



分解禁止



禁止

サイドテーブルを使用するときは、図のように体重をかけないでください。
・転倒する恐れがあります。



⚠ ご使用上の警告と注意



ヘッドボードやフットボードに加湿器の吹出口の風を直接当てたり、濡れた衣類やタオルを掛けしないでください。

・ヘッドボードやフットボードが変色、変形する恐れがあります。



ヘッドボードやフットボードに荷重をかけて、リハビリ等を行わないでください。

・怪我や事故、破損の原因になる恐れがあります。



マットレスを設置しない状態でベッドを使用しないでください。

・ボトムの間隙などに手足の指などがはさまれて怪我をする恐れがあります。

マットレスは、必ず指定のマットレスをご使用ください。(P43～P44 参照)
マットレスの上に布団などを重ねて使用しないでください。

・怪我や事故の原因になります。



マットレスがずれないように注意してください。マットレスがずれると危険な隙間が発生し、体の一部が入り込む恐れがあります。

・付属のマットレスストッパーや適合するサイドレール (P43～P44 参照) を取り付けることでマットレスのずれ防止になります。



使用環境温度は 5℃～40℃です。

使用環境温度を超えるとこ
ろで使用しないでください。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。予めご了承ください。



温熱治療器などベッドの上で電子治療器を使用される場合はベッドの電源プラグを抜いてください。

⚠ リフト使用時の注意



ベッドの下にリフトの脚を挿入し固定する種類があります。本ベッドは、脚部にハイトスペーサー（固定脚タイプ）PH05-45<オプション>を装着することで、高さ調節が可能です。使用されるリフトの種類により脚の高さが異なりますので、詳しくは販売店に確認してください。

⚠ 停電時の注意




停電時には、電源プラグをコンセントから抜いてください。停電時は電動操作ができませんが、復旧した場合は通常通りご使用できます。停電が長引き、かつ背上げしている状態では、使用者の方が腹部の圧迫により呼吸への悪影響がある場合があります。呼吸が苦しそうであれば、ベッドの使用を直ちに中止してください。「停電時の背下げ操作方法 (P50)」もお読みください。




⚠ ご使用上の警告と注意

⚠ ノブボルトはしっかり締め付けてください。

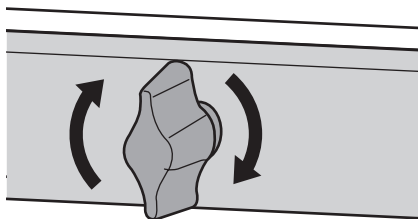


ノブボルトを確実に締め付けてください。
緩んだ状態で使用すると、怪我や破損の恐れがあり危険です。

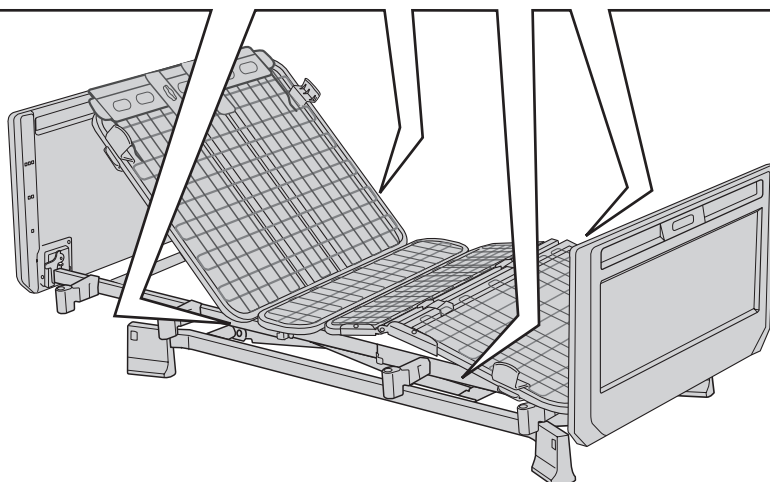

⚠ 指はさみに注意してください。

ボトムが上がっている際には、ボトムの下に手や指を入れないでください。怪我をする恐れがあります。

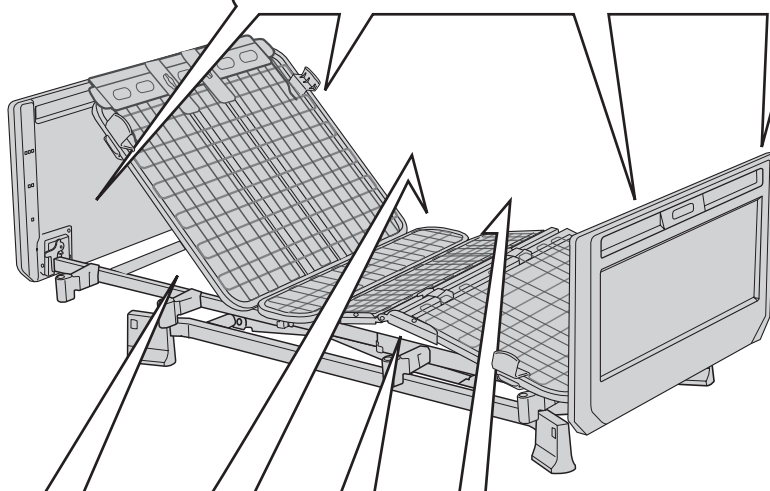


⚠ 指はさみに注意してください。

ボトムが上がっている際には、ボトムの下に手や指を入れないでください。怪我をする恐れがあります。

⚠ ご使用上の警告と注意

⚠ 指はさみに注意してください。

サイドレール及び、ベッド用グリップを装着してボトムを上げる際には、フィッティングバーとの隙間に注意してください。怪我をする恐れがあります。

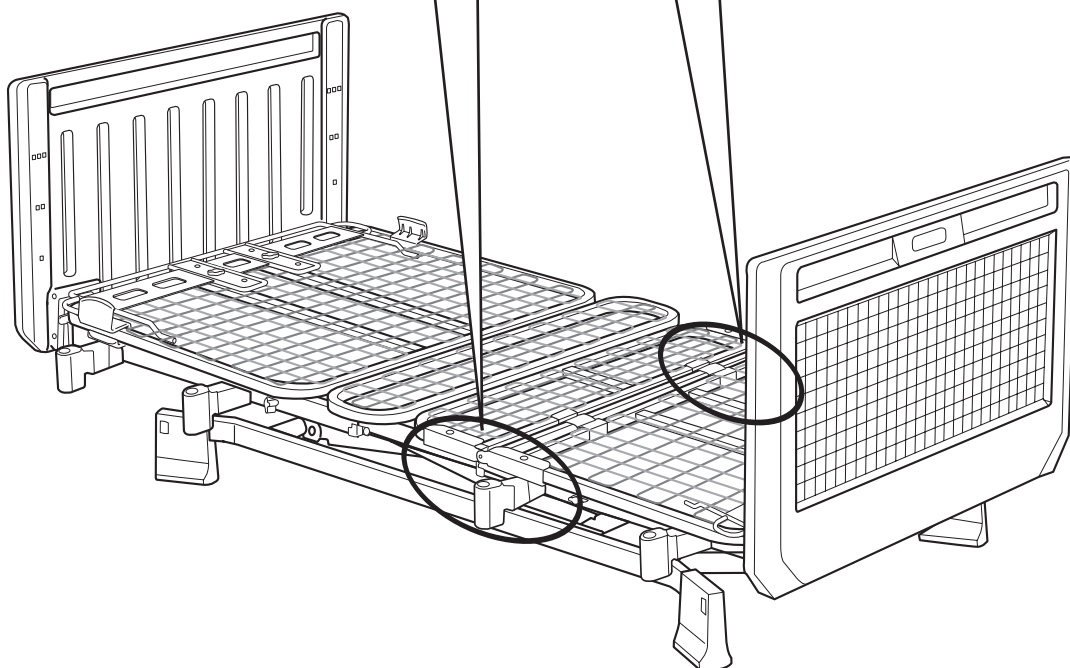

安全のために



ご使用上の警告と注意


⚠ ご使用上の警告と注意

下記のシール類は特に注意していただきたい項目を記載しています。
はがしたり傷つけたりしないでください。

⚠ 警告

- ・取扱説明書に記載のサイドレール、ベッド用グリップ及びマットレスを使用してください。記載以外のサイドレール、ベッド用グリップ及びマットレスを使用されますと、危険な隙間が発生し、重傷死亡事故の原因となる恐れがあります。

株式会社プラッツ

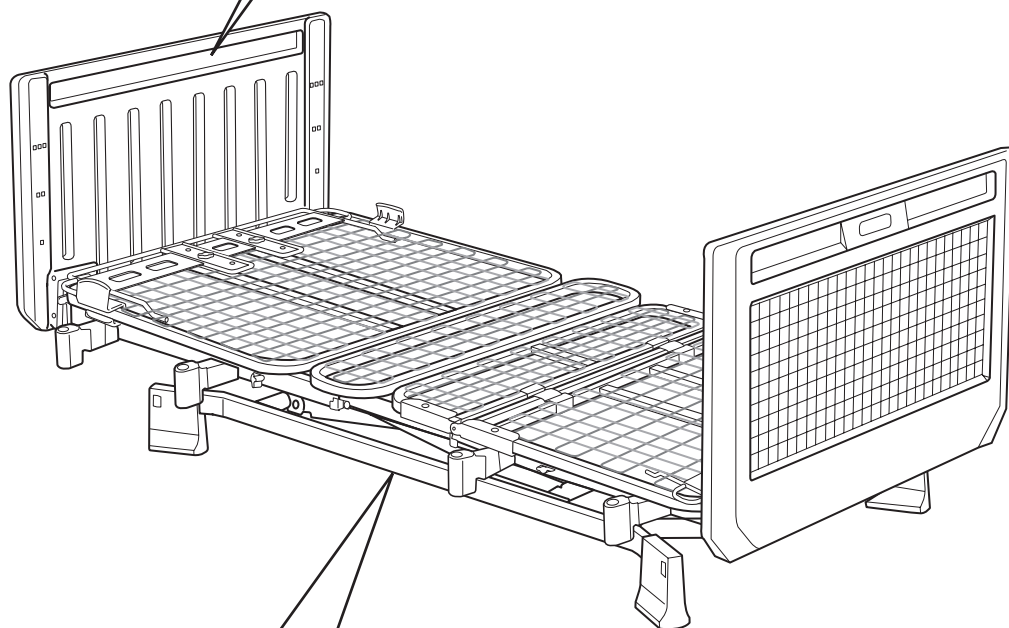


警告

ベッドの下に入ったり、物を置いたりしないでください。
ベッドの下や隙間に体の一部（頭、腕、脚）などを入れないでください。

- ・骨折など、怪我をする恐れがあります。掃除、点検などでベッドの下に入る場合は必ず電源プラグを抜いてください。

ベッドの設置・組み立て・分解は販売店にご相談いただくか、もしくは
本取扱説明書をご覧ください

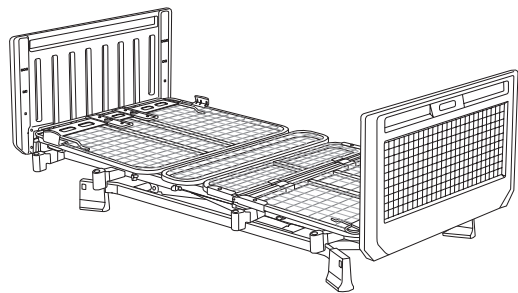

必ず丈夫で水平な床に設置してください。


ベッドの重量（マットレスや周辺機器を含む）と使用される方の体重（例：80 kg）を合わせると約 200 kg の総重量となります。この荷重に十分耐えられる水平な場所へ設置してください。

※最大使用者体重：138 kg


ベッドの滑り止めや床のキズ防止のために、
ベッド専用のカーペット（PSC-1216SC）をおすすめします。

お願い

- ベッドの周りは出来るだけ広い空間を確保してください。
 - ・療養される方のベッドからの移乗や介護する場合のスペースを充分検討して設置してください。
- 電源コンセントの位置から 10 cm 程度離し、昇降時に電源プラグとベッドが接触しないようにしてください。
- ベッドの下に物を置かないでください。
 - ・昇降時にベッドが破損したり、ベッドが斜めに傾くことがあります危険です。

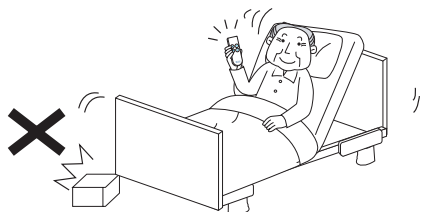


設置参考図

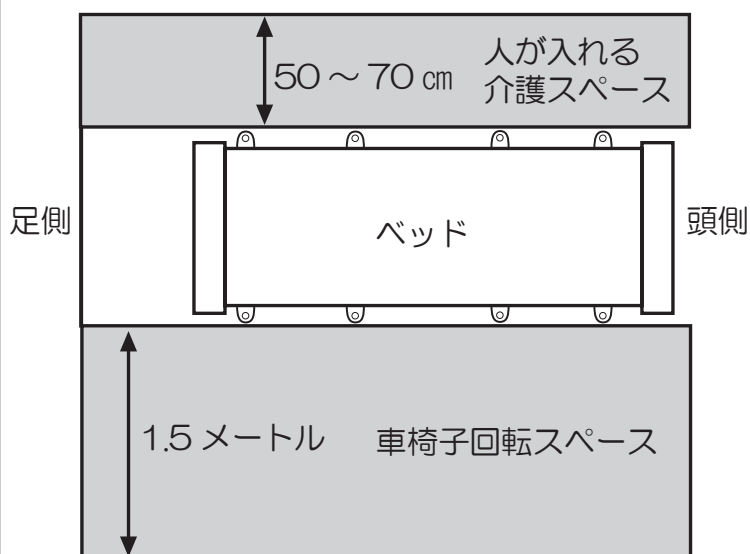




禁止

- ストープや火気のある物などをベッドの近くに設置しないでください。
- 機器の変形や変色、火災の原因になり非常に危険です。




禁止

- 配線器具の定格を超える「たこ足配線」や表示された電圧（100V- 240V）以外の電圧では使用しないでください。
- 火災やモーター故障の原因になります。



禁止

- 電源コードや手元スイッチのコード等を、引っ張ったり、はさまないようにしてください。
- 断線が発生し、感電、発火、モーターの故障の原因になります。






禁止

- 組み合わせるサイドレール、ベッド用グリップは適合周辺機器以外は使用しないでください。
- 危険な隙間が発生し、腕や首、頭をはさむなど重大事故の原因になります。

移動について

- 組み立てが終わった状態で移動する場合、下図矢印位置を持って移動してください。

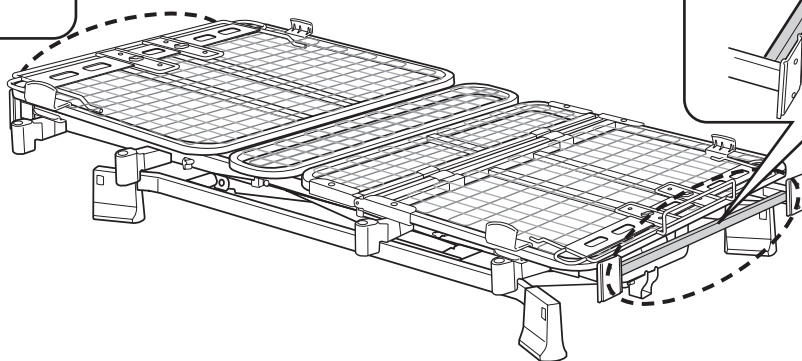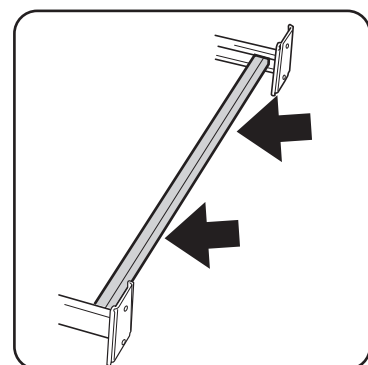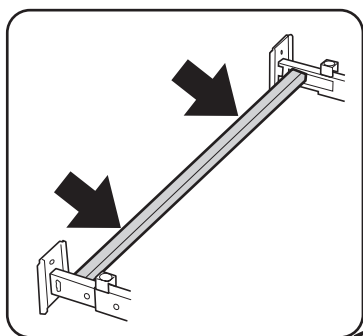


- ベッドは約 80kg あります。腰や背中などを痛めないよう、少なくとも4人以上で移動を行ってください。
- 移動前に必ずヘッドボード・フットボード、サイドレール、マットレスなどを外してください。
- 電源プラグを抜き、手元スイッチのコードに注意してください。
- 人が乗った状態で、移動を行わないでください。
- 移動する前にピンが確実に取り付けられている事を、必ず確認してください。
（21 ページ参照） ※怪我、事故の原因になる事があります。
- ヘッドボード・フットボードの外しかたは 26 ページを参照してください。


手元スイッチ

- ベッドの操作を行うことができます。
- 上部のフックでサイドレールに引っ掛けることができます


背上げ 1 モーターベッド

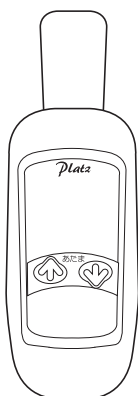


2 モーターベッド

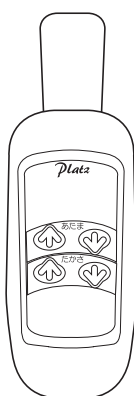

3 モーターベッド

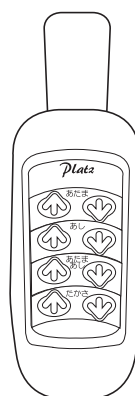

*仕様変更により、イラストと仕様が変わる場合があります

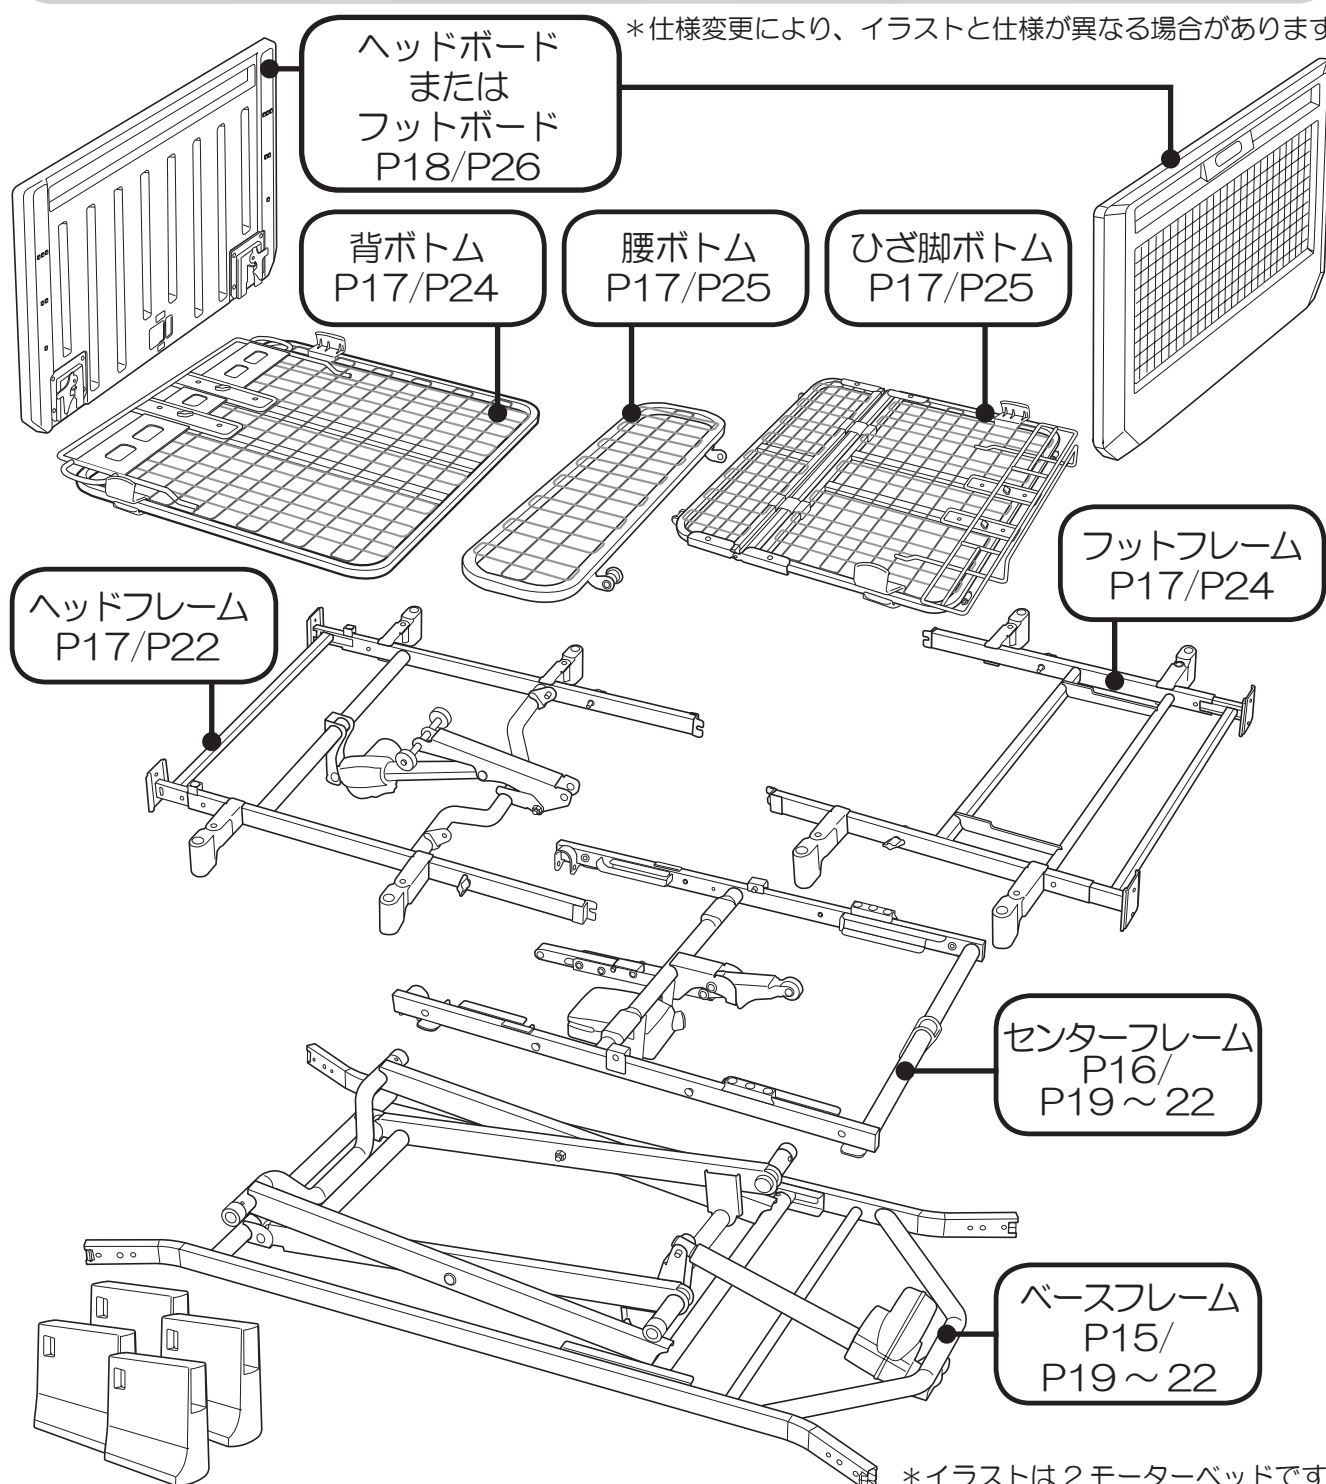

*イラストは2モーターベッドです。


●商品が到着した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか下記欄へチェックをしながら確認をしてください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

(例)

固定脚× 4




ベースフレーム
PP113-ZHZ-1/5
梱包 (1/5)
昇降モーター付

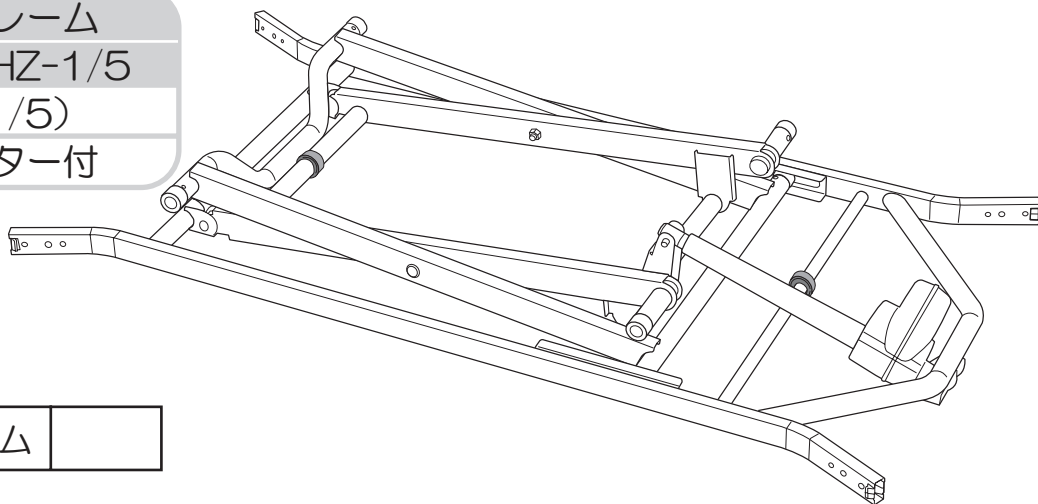


ベースフレーム

ベースフレーム
PP113-ZNZ-1/5
梱包 (1/5)
高さ固定タイプ

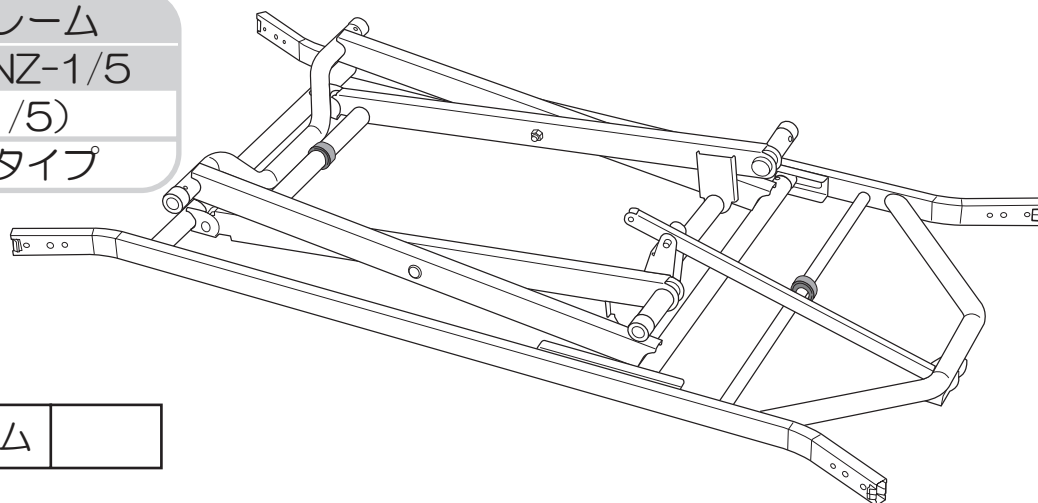


ベースフレーム

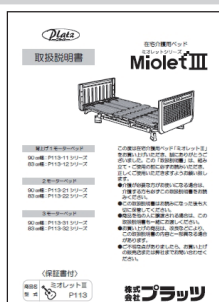


取扱説明書
(本書)〈保証書付〉


組み立て
チェックリスト



固定脚× 4



部品パック



ピン × 3



割りピン × 5




* 3 モーターベッドは
「ピン× 1」「割りピン× 1」
が余ります。

センターフレーム
PP113-1AZ-2/5
梱包 (2/5)
背上げ1 モーターベッド




手元スイッチ

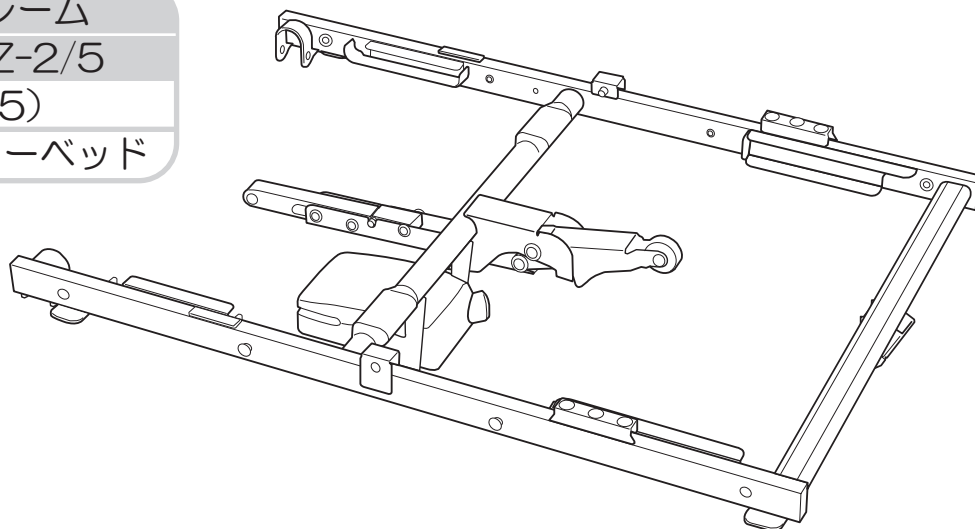


センターフレーム

センターフレーム
PP113-2AZ-2/5
梱包 (2/5)
2 モーターベッド

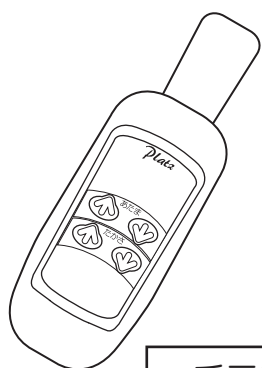


手元スイッチ

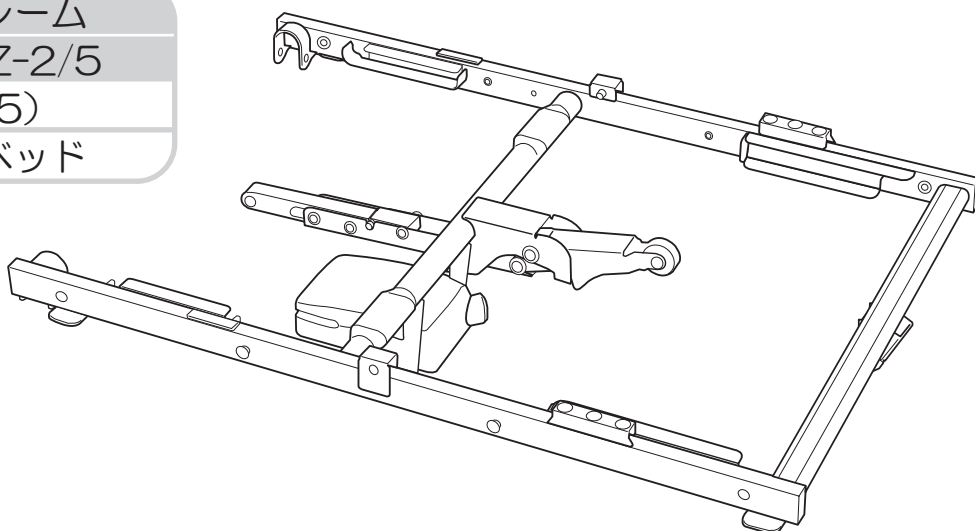


センターフレーム

センターフレーム
PP113-3AZ-2/5
梱包 (2/5)
3 モーターベッド

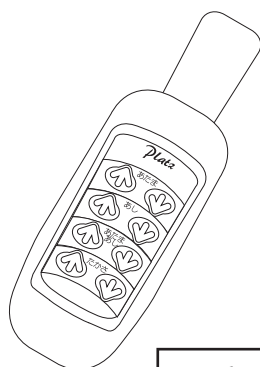

手元スイッチ

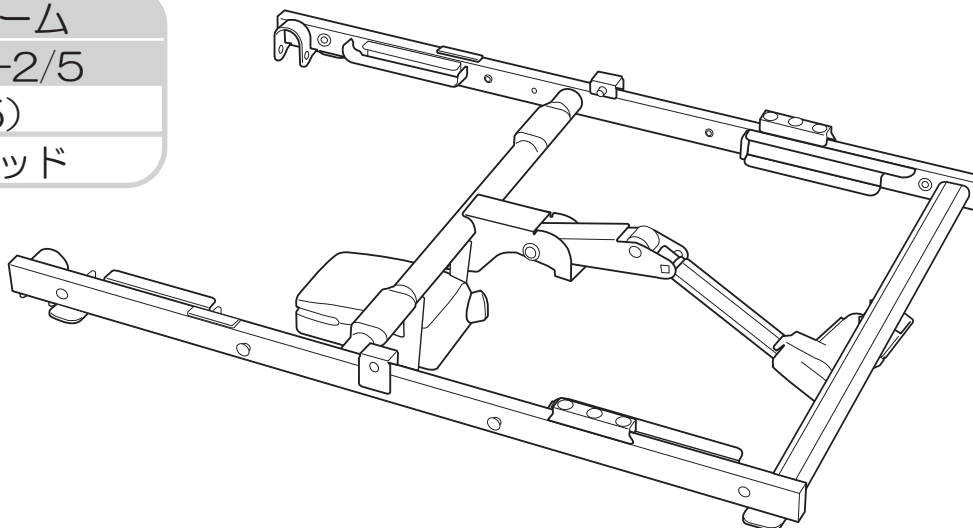


センターフレーム

ヘッドフレーム・フットフレーム
PP113-BAZ-3/5
梱包 (3/5)
90 cm幅専用

フットフレーム


ヘッドフレーム

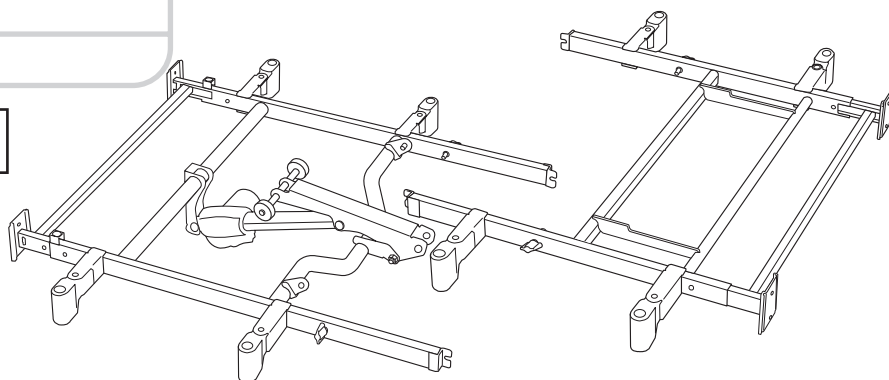

ヘッドフレーム・フットフレーム
PP113-BBZ-3/5
梱包 (3/5)
83 cm幅専用

フットフレーム

ヘッドフレーム

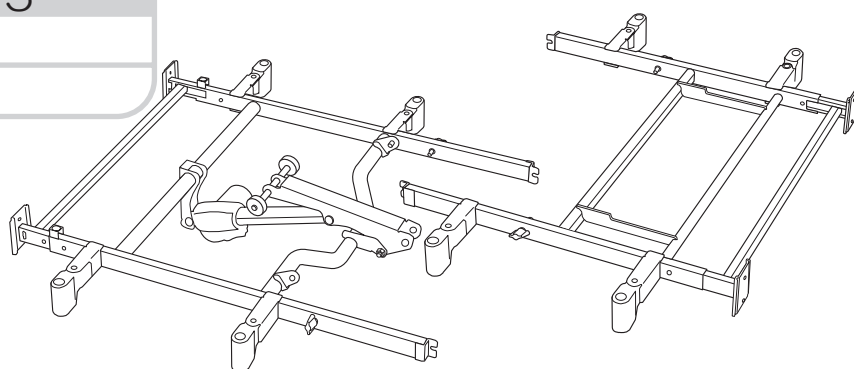

ボトムセット
PP113-ZAZ-4/5
梱包 (4/5)
90 cm幅専用

マットレスストッパー×4

マットレスストッパー

マットレスストッパー

マットレスストッパー

マットレスストッパー

背ボトム

腰ボトム

ひざ脚ボトム

ボトムセット
PP113-ZBZ-4/5
梱包 (4/5)
83 cm幅専用

マットレスストッパー×4

マットレスストッパー

マットレスストッパー

マットレスストッパー

マットレスストッパー


背ボトム

腰ボトム

ひざ脚ボトム

樹脂ボードセット
PP113-ACZ-5/5
梱包 (5/5)
90 cm幅専用 (H/H)

ヘッドボード×2

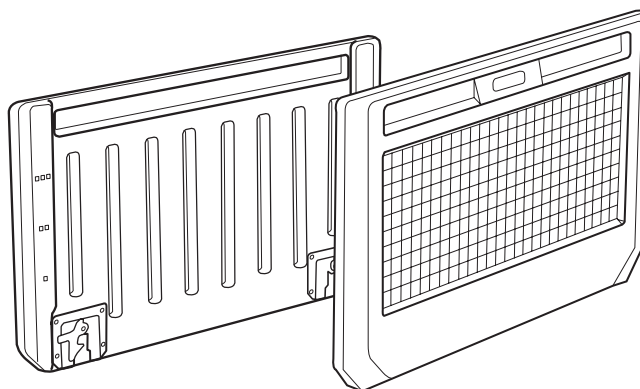


木製ボードセット
PP113-BAZ-5/5
梱包 (5/5)

90 cm幅専用 (フラットタイプ H/F)

ヘッドボード

フットボード

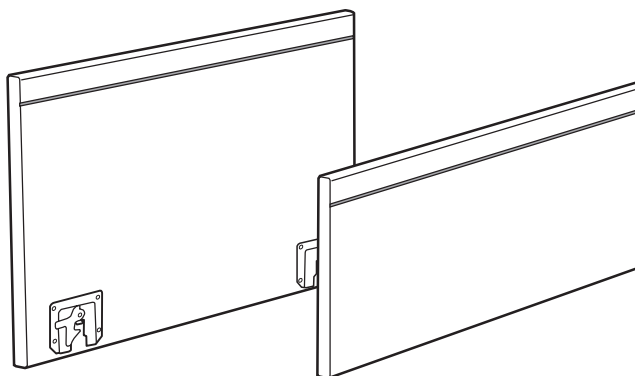


木製ボードセット
PP113-BBZ-5/5
梱包 (5/5)

90 cm幅専用 (宮 H/F)

宮ヘッドボード
PP113-B3Z-5/5


フットボード
PP113-B2Z-5/5

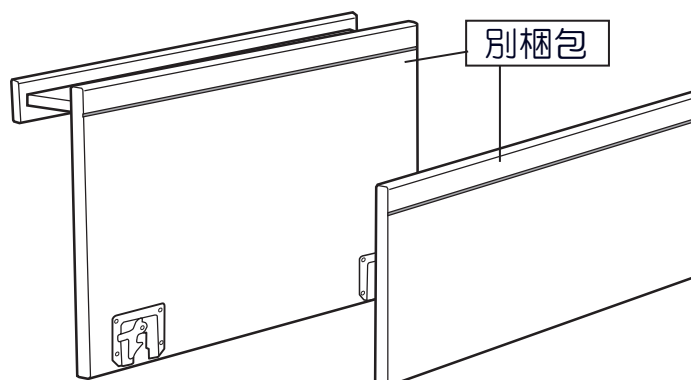

樹脂ボードセット
PP113-CCZ-5/5
梱包 (5/5)

83 cm幅専用 (H/H)

ヘッドボード×2

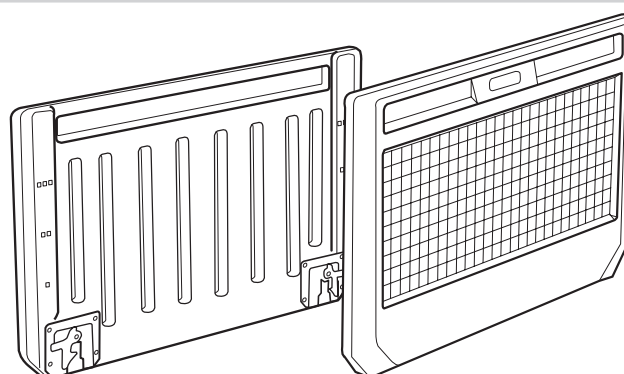


木製ボードセット
PP113-DAZ-5/5
梱包 (5/5)

83 cm幅専用 (フラットタイプ H/F)

ヘッドボード

フットボード

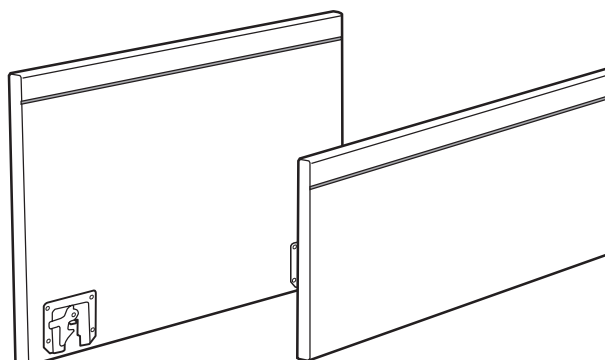

ピン
の色
について

- 黒 黒のピンは取り外ししません
- 銀 銀のピンは取り外します
- 金 金のピンは必要に応じて取り外します



組み立ての際に、手や指をはさまないようにご注意ください

ベースフレームとセンターフレームを組み立てます


1

ベースフレーム

あたま側


ベースフレームを準備します。あたま側、あし側の位置を確認してください。図のように固定脚を取り付けてください。

あし側

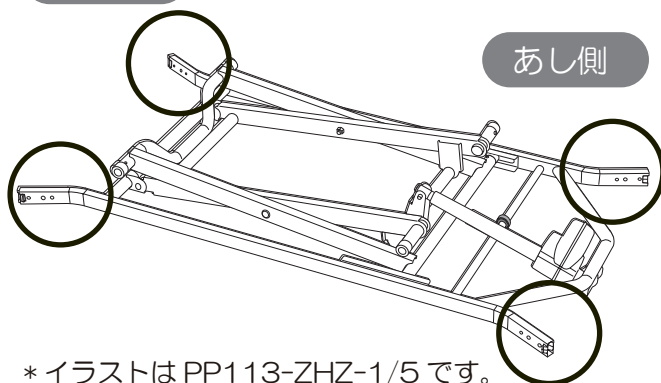


* イラストは PP113-ZHZ-1/5 です。
他機種も組み立てかたは共通です


- ①ベースフレームに固定脚をしっかりと差し込みます。

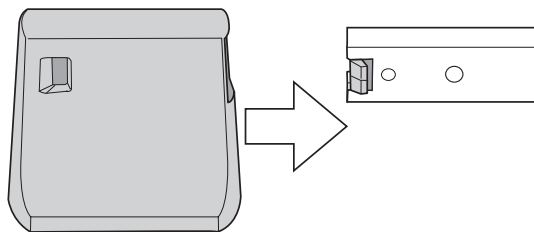

- ②この部分が
カチッと
引っ掛かる
まで、固定脚
を挿し込んで
ください。

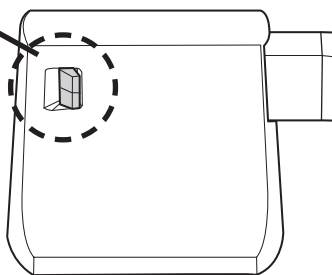

- ③ 4 箇所に取付けます。

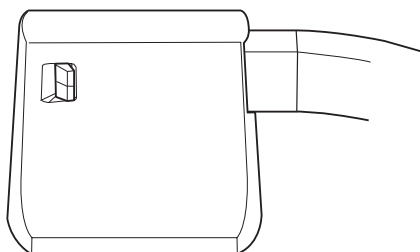


背上げ 1 モーター以外は
「2」へ進んでください

オプションについて


キャスター仕様

専用キャスター（オプション）を取り付けてキャスター仕様にすることができます。適合周辺機器（P43～P44）をご覧ください。

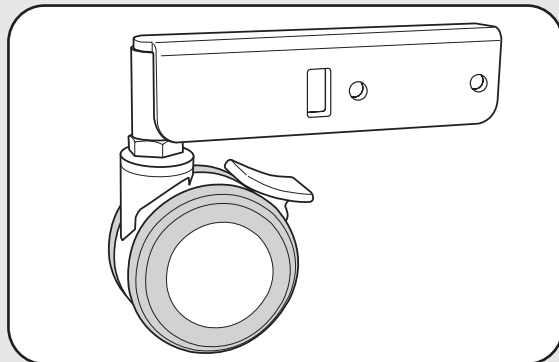



ハイトスペーサー仕様

床面を上げるためのハイトスペーサー固定脚タイプ（オプション）を取り付けることができます。適合周辺機器（P43～P44）をご覧ください。

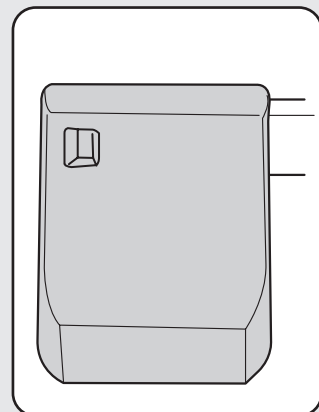

背上げ 1 モーター用
ベースフレームの組み立て
高さ切り替えバーの切り替え

「高さ切り替えバー」の取り付け位置で、床面高さを『25 cm』と『31 cm』の 2 種類から選ぶことができます。梱包時は床面高さ『25 cm』の位置に取り付けてあります。

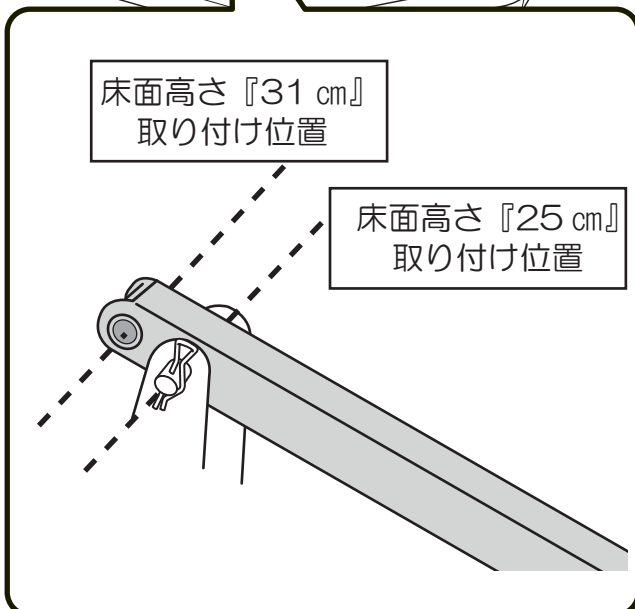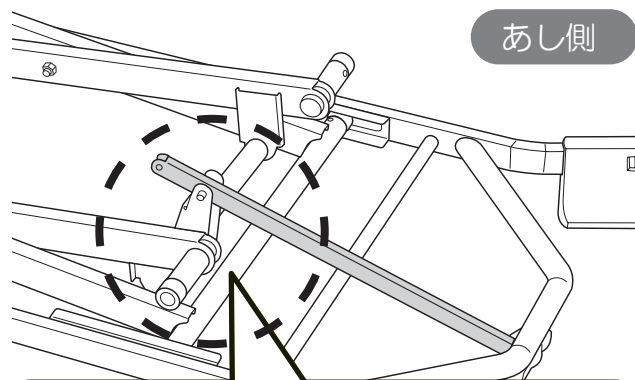

『25 cm』と『31 cm』の 2 種類から高さを選び、ピンと割りピンでしっかり取り付けます。



確認



しっかり取り付けられているか
確認してください

2

センターフレームを
ベースフレームに取り
付けます。



センターフレーム

①ベースフレーム "①-A"、"①-B" 先端部分をセンターフレームの溝部分に挿し込みます。

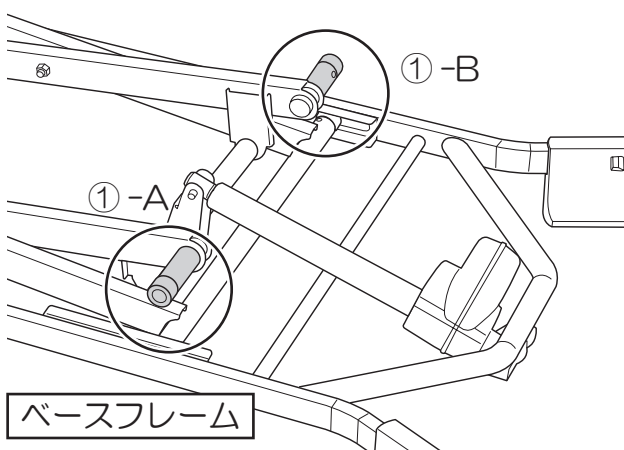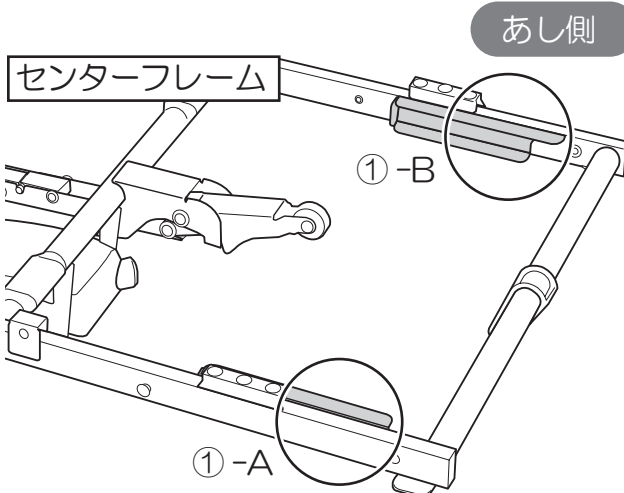

ベースフレーム

②先端部分を溝に沿ってスライドさせ、奥まで挿し込みます。

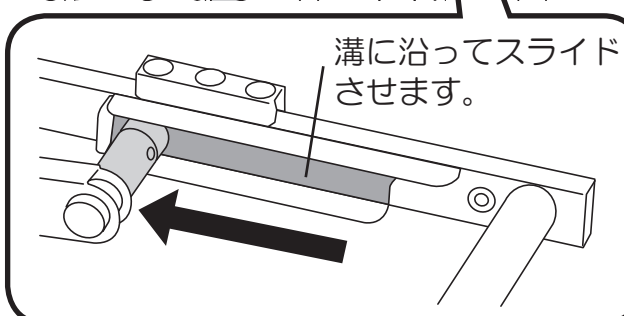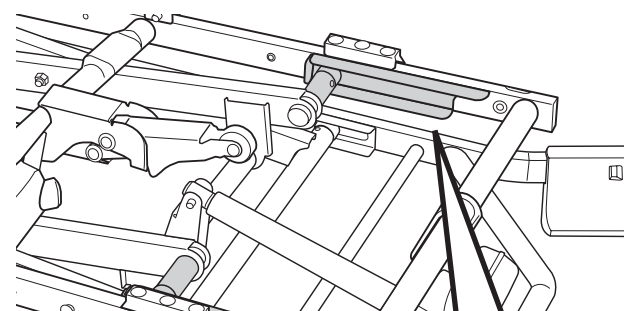


③ "②-A"、"②-B" を
ピンと割りピンで取り
付けます。

センターフレーム


あたま側

ベースフレーム




ピンと割りピン
で取り付けます。

※ピンは必ずイラストの
方向に挿してください。

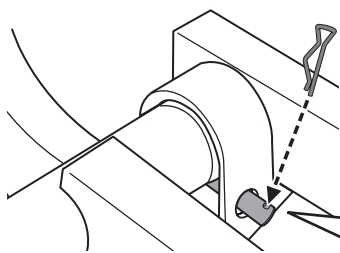

反対側からピ
ンの穴に割り
ピンを挿し込
んで取り付
けます。

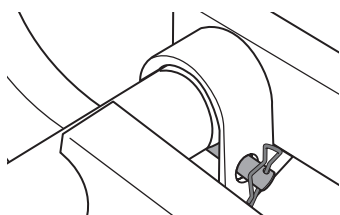


確認

ピンと割りピンがしっかり取り
付けられているか確認してくだ
さい

手元スイッチコードの取り廻し

手元スイッチを梱包のビニール袋から取り出
してください。

手元スイッチコードは、このベースフ
レームのX型昇降パイプの上を通してく
ださい。X型昇降パイプの間を通すと、
コードの破断や故障の原因となります。

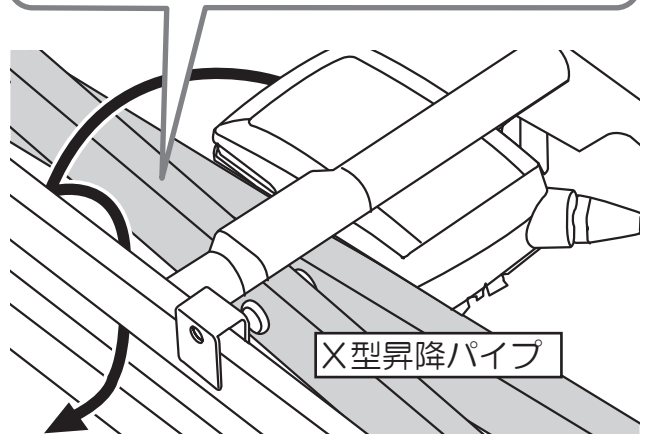


X型昇降パイプ


反対方向に取り廻す場合

①この下を通して
ください。

②X型昇降パイプ
の上を通して
ください。

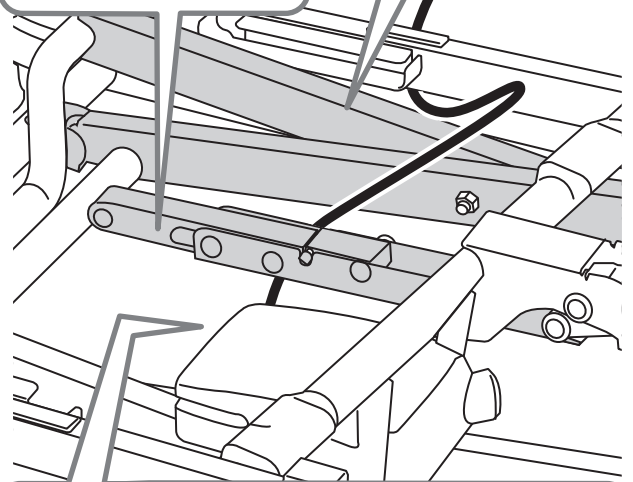

反対方向に取り廻す
場合は、コードを反
対側の切り欠きに嵌
め込んでから取り廻
してください。

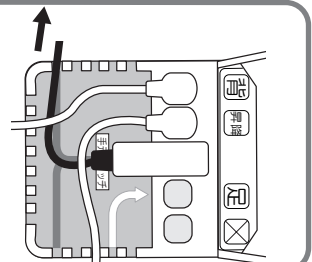

確認




コードのはさみ込みが無いよう
に取り廻してください。

背上げ 1 モーターはP22「3-1」へ
進んでください


背上げ 1 モーター以外は
「昇降モーターの取り付け」へ
進んでください

昇降モーターコードの取り付け

昇降モーターのコードをコードクリップに取り
付け、電源部の「昇降」にプラグを挿し込
みます。

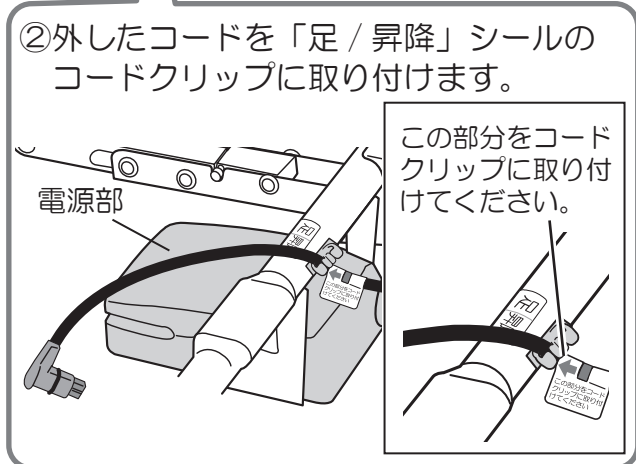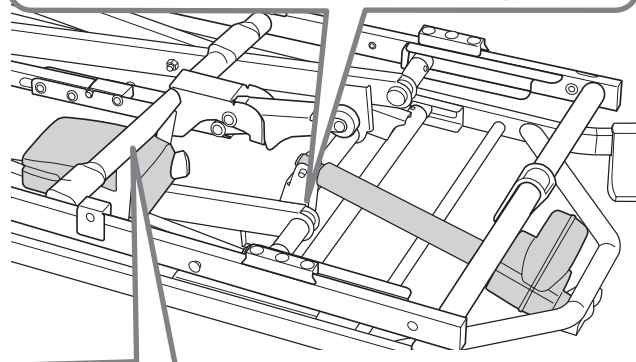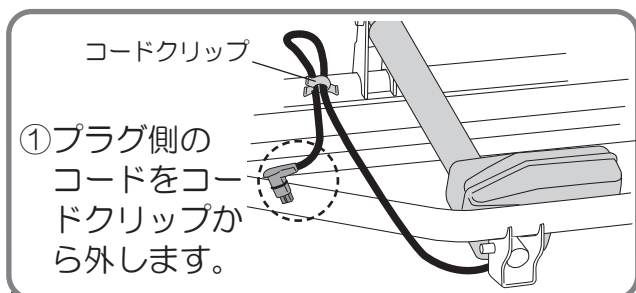


③電源部の「昇降」に挿し込まれているキャ
ップを外し、昇降モーターのプラグを挿し
込みます。外した
キャップは部品パック
に収納してください。



挿し込んだコードは、
シールを参考にして取り
付けこの切り欠き部分に
取り付けてください。

電源部側のコードがピンと張った状態に
なるように取り付けてください。

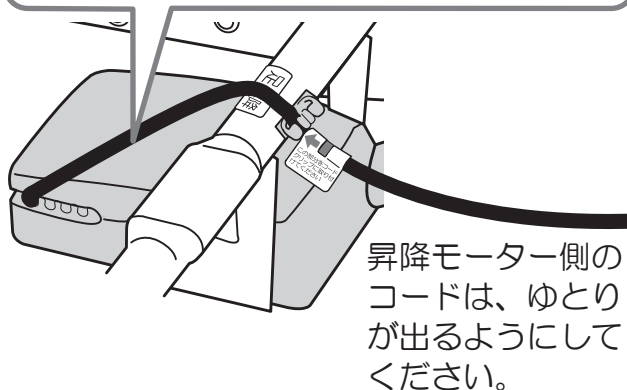

確認


しっかり取り付けられているか
確認してください

ヘッドフレームを取り付けます

3-1


ヘッドフレーム

ヘッドフレームを取り
付けます。


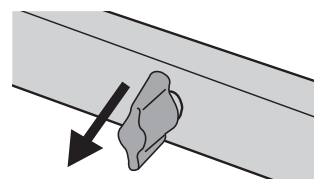


①両側のノブボルトを外側に引っ張って
から組み立ててください。

②センターフレーム
の突起にヘッドフ
レームの凹部を引
っ掛けます。




③静かにセンターフ
レームの上に載せ
ます。

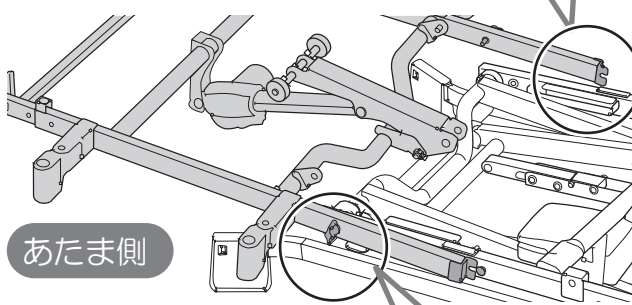


あたま側

両側からノブボルト
で、しっかり締め付
けます。



[illegible]

④ "④ - A、"④ - B をピンと割りピンで
取り付けます。


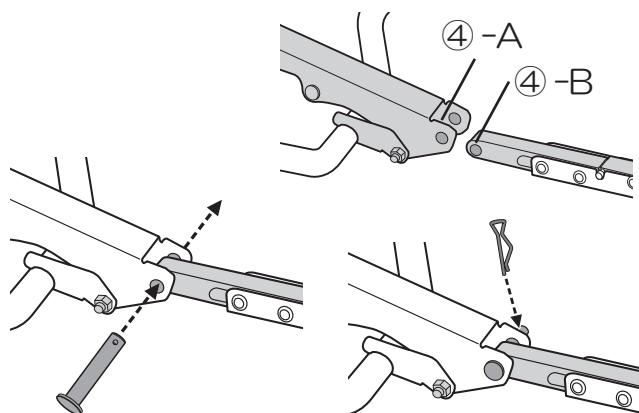


ピンと割りピンがしっかり取り付けられているか確認してください


背モーターコードの取り付け

背モーターのコードをコードクリップから取り外し、電源部の「背」にプラグを挿し込みます。

①プラグ側のコードをコードクリップから外します。

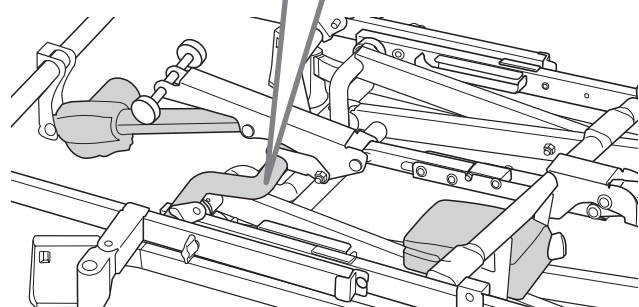
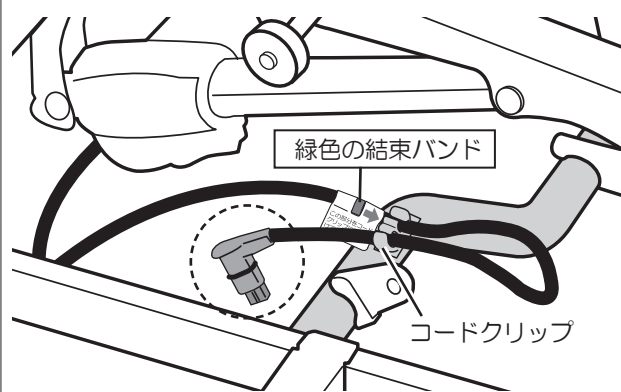


②電源部の「背」に背モーターのプラグを挿し込みます。

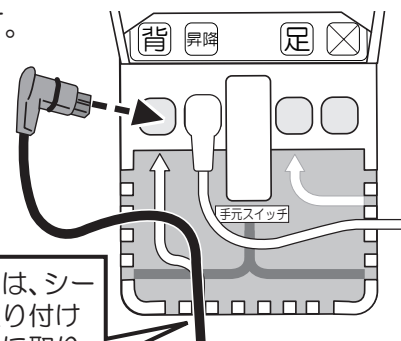

挿し込んだコードは、シートを参考にして取り付けこの切り欠き部分に取り付けてください。

コード部分を切り欠き部分に嵌め込んで、しっかりふたを閉じてください。

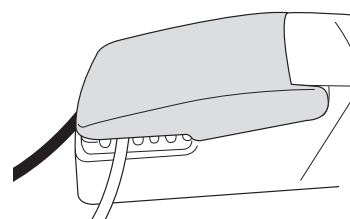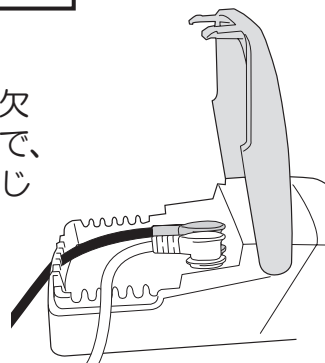

フットフレームを取り付けます


4

フットフレームを取り付けます。

フットフレーム

- ①両側のノブボルトを外側に引っ張ってから組み立ててください。

ヘッドフレームの取り付けかた②・③を参照し、フットフレームを取り付けてください。

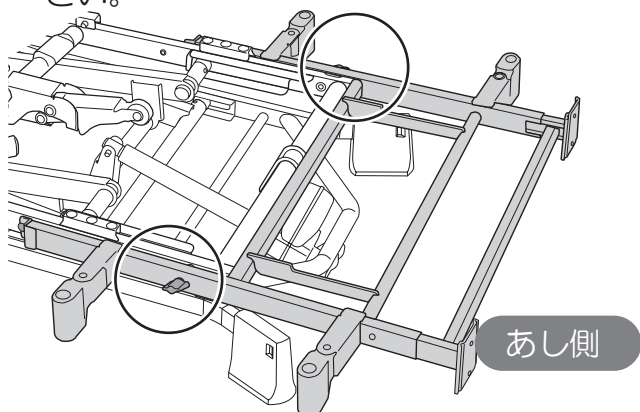

あし側

背ボトムを取り付けます


5-1

背ボトムを取り付けます。

背ボトム

あたま側


- ①背ボトムのローラーをローラーガイドに挿入します

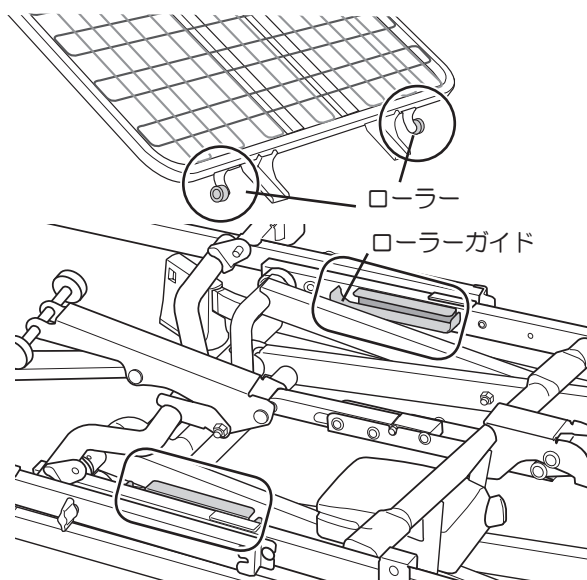


ローラー

ローラーガイド

- ②背ボトムを矢印方向に動かしながら、バックオフバーを取り付けます。

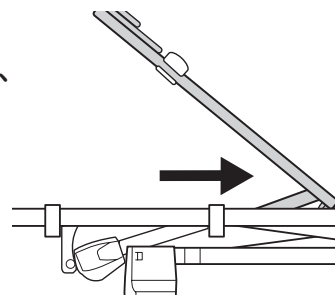


バックオフバー

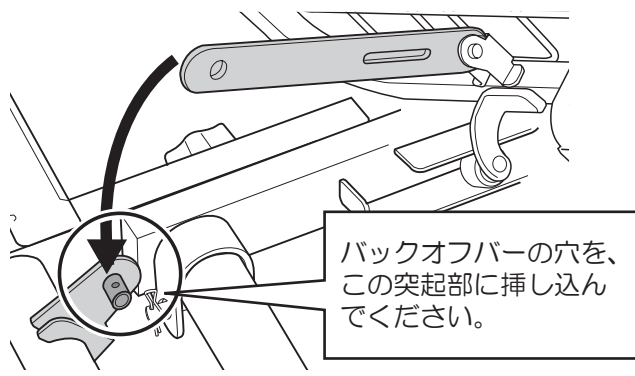


バックオフバーの穴を、この突起部に挿し込んでください。

割りピンで取り付けてください。

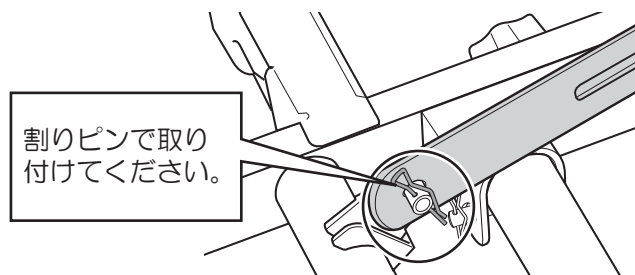

※反対側のバックオフバーも同じように取り付けてください。

- ③背ボトムを倒してください。

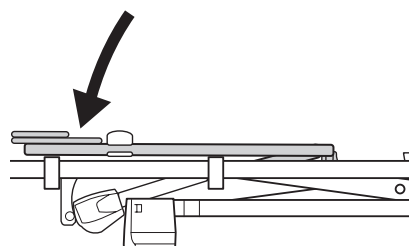

確認

割りピンがしっかり取り付けられているか確認してください

全機種共通

組み立てかた

フットフレーム3/5・ボトムセット4/5



腰ボトム・ひざ脚ボトムを
取り付けます

5-2


腰ボトム

腰ボトムを取り付けま
す。

- ①腰ボトムの穴を、センターフレームの突起に挿し込みます。

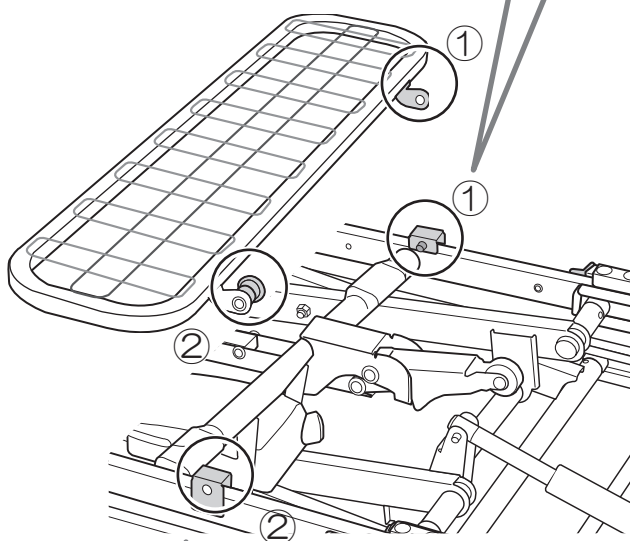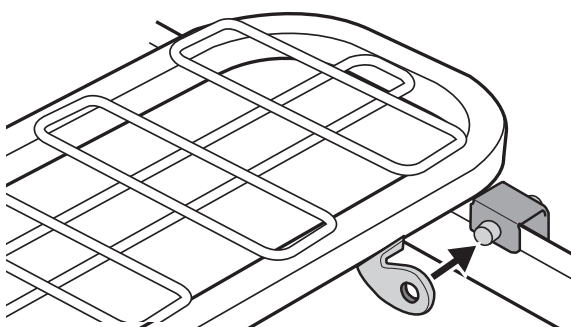

- ②腰ボトムのロックピンを引っ張りながら、センターフレームの穴に挿し込みます。


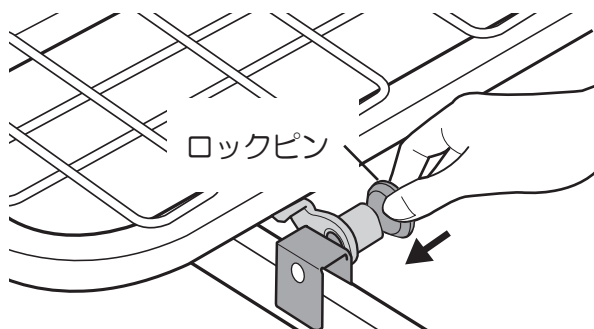


5-3


ひざ脚ボトムを取り付
けます。

ひざ脚ボトム

- ①ひざ脚ボトムの穴を、センターフレームの突起に挿し込みます。

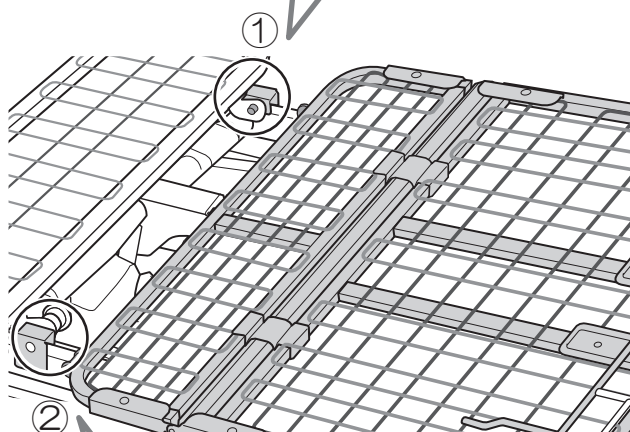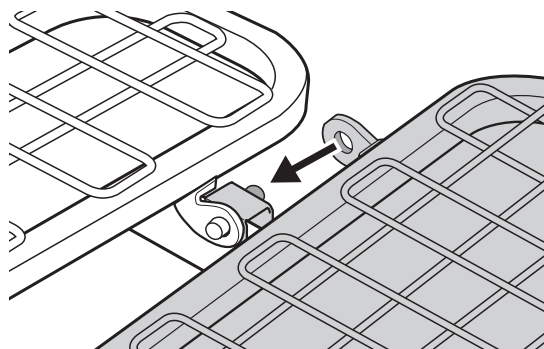

- ②ひざ脚ボトムのロックピンを引っ張りながら、センターフレームの穴に挿し込みます。

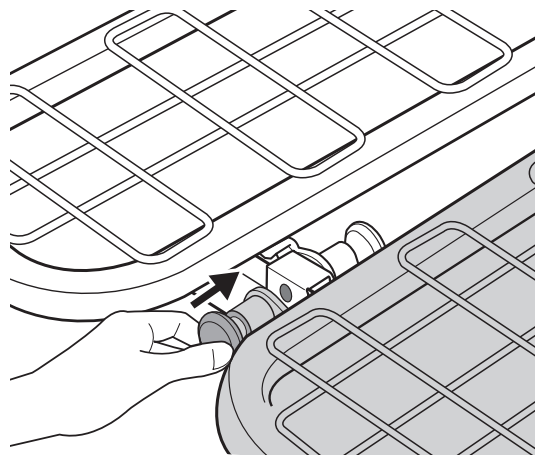

確認



ひざ脚ボトムがしっかり取り付
けられているか確認してくださ
い

ボードセットを取り付けます

6

ヘッドボード、フットボードを取り付けます。


ヘッドボード
フットボード

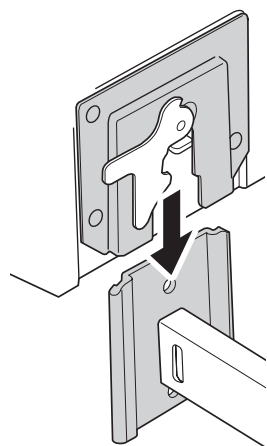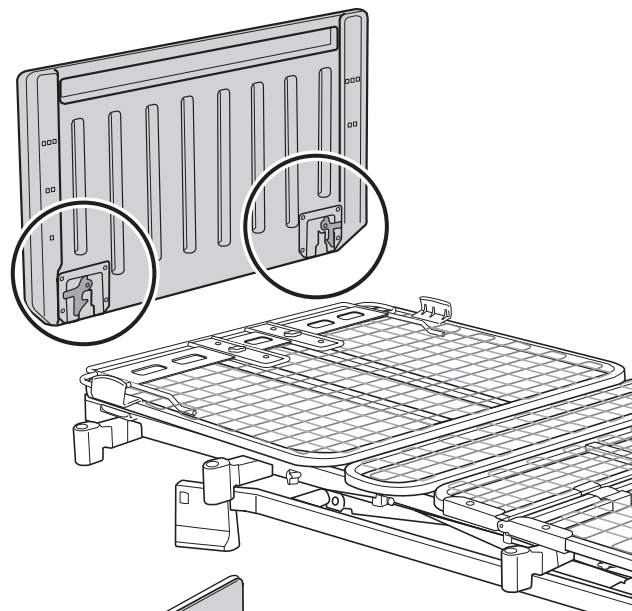

①ヘッドボードを取り付け金具に真上から挿し込みます。

②ボード側の留め具が取り付け金具の穴部に引っ掛かっていることを確認してください。

③同様に、あし側にもフットボードを取り付けます。




確認

ヘッドボード、フットボードともしっかり取り付けられているか確認してください

電源コードを差し込んでください

7

最後に電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。

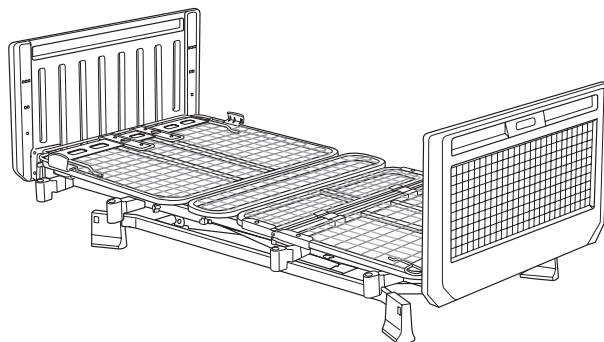

※ベッドの分解方法

- ボードの留め具を上げてボードを取り外します。
- 組み立てかたを参照に逆の手順で行ってください。



警告




ベッドを一定期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる場合は、電源プラグを抜いてください。誤操作による事故の恐れがあります。


コードの取り廻し

電源コードの取り廻し

コードは、ベースフレームのX型昇降パイプの上を通してください。X型昇降パイプの間を通すと、コードの破断や故障の原因となります。

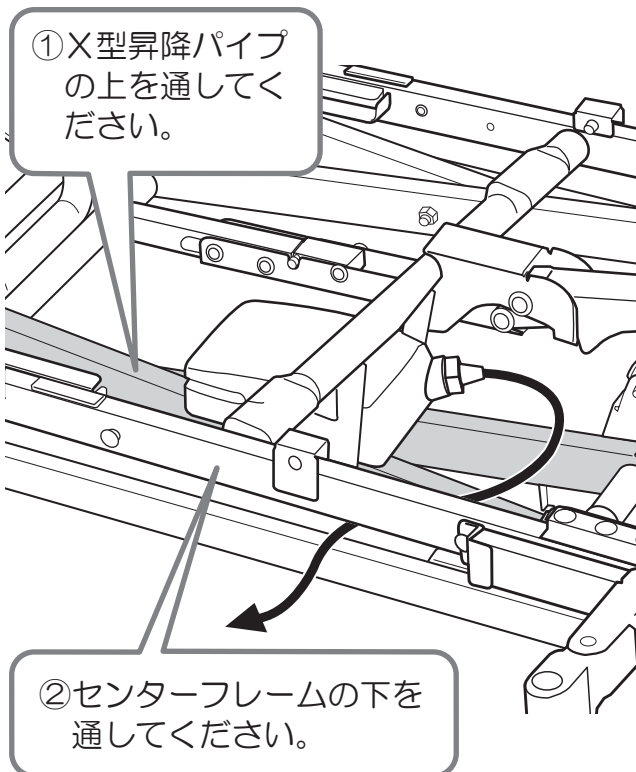


反対方向に取り廻す場合

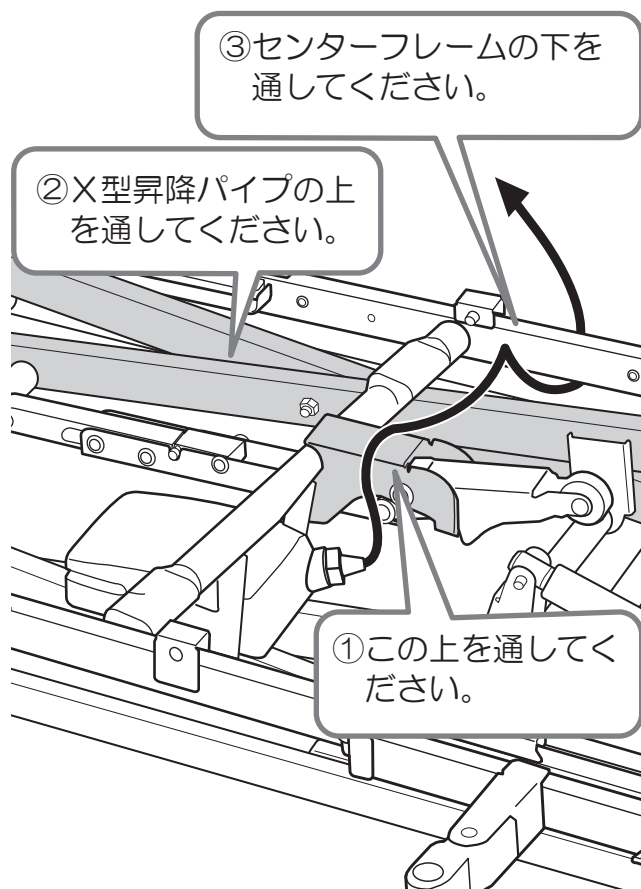

手元スイッチコード、電源コード：コードクリップ位置


下図4箇所に「手元スイッチコード」「電源コード」取り廻し用の『コードクリップ』があります。適当な場所のコードクリップにコードを取り付けてご使用ください。

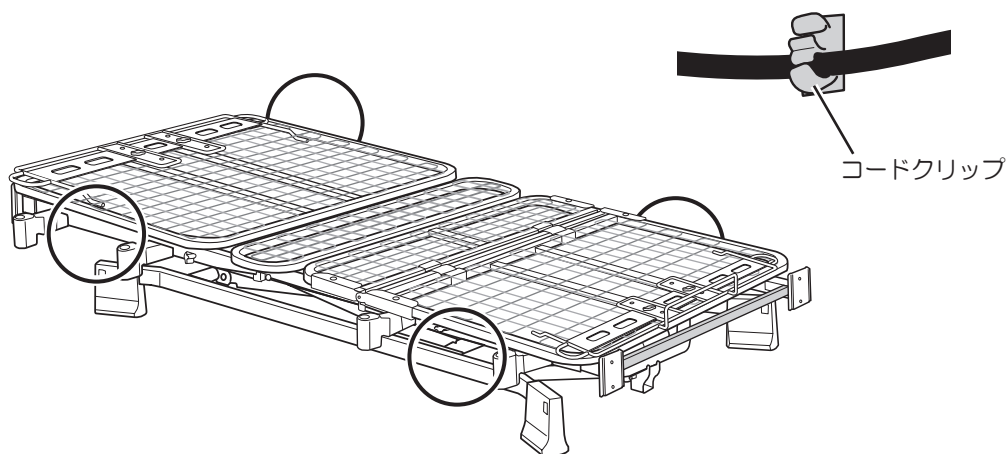

手元スイッチの使いかた

- ベッドの背ボトムの角度やベッド全体の高さを手元スイッチ操作で無段階に調節できます。手元スイッチのボタンを押すと作動し、ボタンを離すとその位置で停止します。使いやすい位置まで作動させてベッドをお使いください。

背上げ 1 モーターベッド

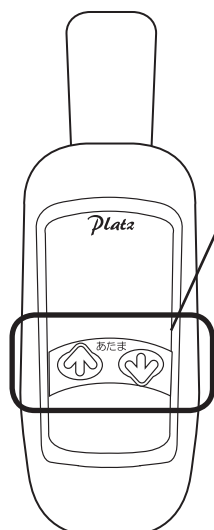


あたまボタン

背ボトムの角度を 70° 、ひざ角度を 22° まで無段階に調節できます。

※下記参照ページもご覧ください。

- ライジングモーション：P30
- 背のみ / 背あし連動：P30

2 モーターベッド

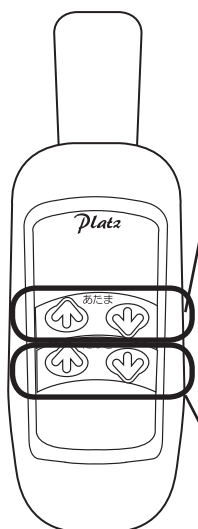

あたまボタン

背ボトムの角度を 70° 、ひざ角度を 22° まで無段階に調節できます。


※下記参照ページもご覧ください。

- ライジングモーション：P30
- 背のみ / 背あし連動：P30

たかさボタン

床面高さを 25 ～ 59 cm まで無段階に調節できます。

3 モーターベッド

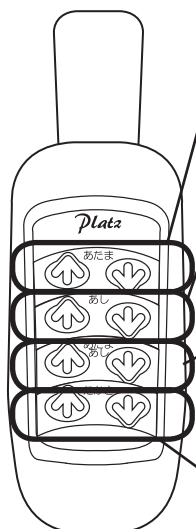

あたまボタン

背ボトムの角度を 70° まで無段階に調節できます。

あしボタン

ひざボトム角度を 18° まで無段階に調節できます。

あたまあしボタン

背ボトムの角度、ひざボトム角度を同時に調整できます。

たかさボタン

床面高さを 25 ～ 59 cm まで無段階に調節できます。



警告

！ ベッドを一定の期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる場合は電源プラグを抜いてください。誤操作による事故の恐れがあります。

！ 操作は必ずベッドに寝た状態で行ってください。ベッドに立った状態や座った状態での操作は怪我をする恐れがあり危険です。

⊘ 2 つ以上のボタンを同時に押さないでください。手元スイッチやモーターの故障の原因になります。



レギュラー／ショート／ロングの切り替え

- 「ヘッドフレーム・フットフレーム」「ボトムセット」の設定の変更でレギュラー／ショート／ロングの長さ切り替えができます。（初期設定はレギュラーサイズです）

ヘッドフレーム・フットフレーム
の長さ切り替え


- ①ヘッドボード、フットボードを取り外します。
- ②イラストの長さ設定位置に合わせ、ピンと割りピンで取り付けます。

あたま側

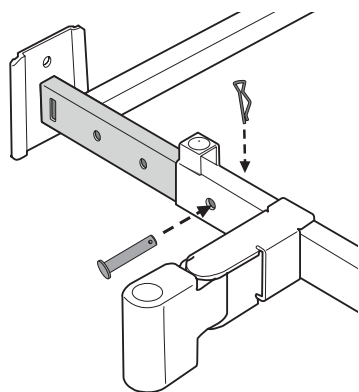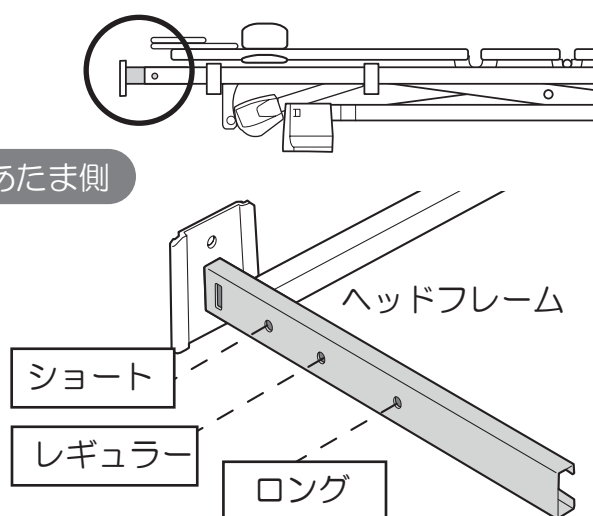


- ③左右2箇所とも同じ長さに設定して取り付けてください。
- ④同様にフットフレームも長さ設定して取り付けてください。

あし側

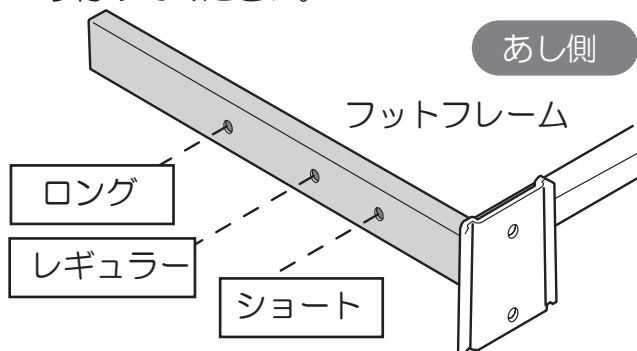背ボトム・ひざ脚ボトム
の長さ切り替え


- ①先端を背ボトムのネットの下側に入れ込んでください。

あたま側

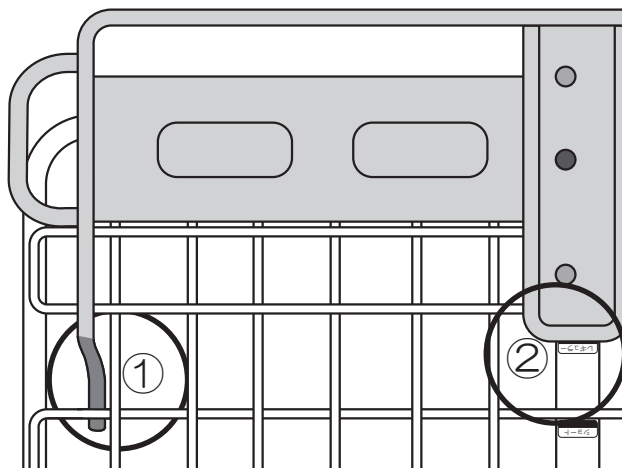


- ②背ボトムの「ショート」「レギュラー」「ロング」印のいずれかに合わせます。

※ヘッドフレーム、フットフレームと同じ長さに設定にしてください。



- ③ボルトをしっかり締め付けてください。左右2箇所とも同じ長さに設定して取り付けてください。

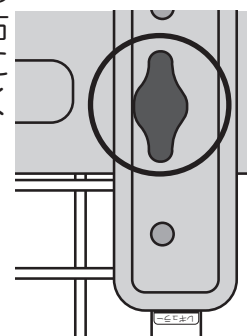

- ④同様にひざ脚ボトムも長さ設定して取り付けてください。

- ⑤ヘッドボード・フットボードを取り付けます。




確認

しっかり取り付けられているか
確認してください

ライジングモーション(背上げ1モーター・2モーター)

ライジングモーションの目的

※どの角度においても背とひざの角度は90度以上のため、腹部圧迫を軽減します。
※背ボトムとひざボトムを連動させたりクライニング動作で、背上げ時の身体のスレを防止します。

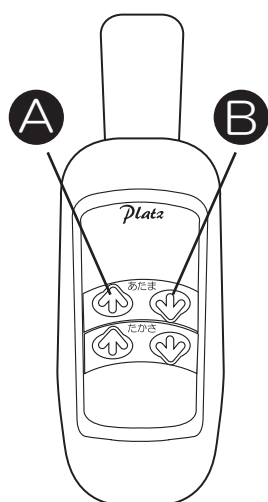


背を上げる場合

- A**を押し続けることにより
- ①背、ひざが上がり始めます。
 - ②背が22°、ひざが22°になるまで上がり続けます。(図B)
 - ③背が上がり続けます。(図C)
 - ④背が70°まで上がり、ひざは水平になります。(図D)


背を下げる場合

- B**を押し続けることにより
- ①背が下がり、ひざが上がり始めます。(図C)
 - ②背が22°になるまで下がり、ひざが22°になるまで上がります。(図B)
 - ③背下がります。
 - ④背とひざが水平になります。(図A)


図A

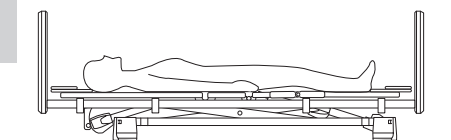


図C

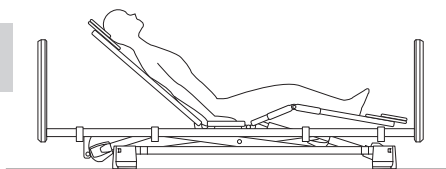

図B

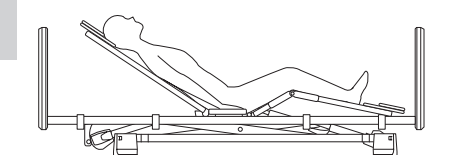


図D

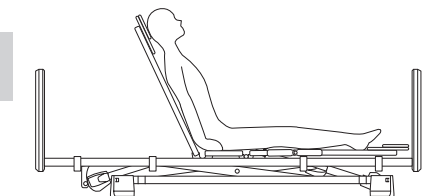

「背あし連動」「背のみ」の切り替え

ご利用者様と寝具をベッドから降ろして作業を行ってください。



- ①手元スイッチを使い背ボトム、ひざ脚ボトムを完全に下げます。
- ②電源コードを抜きます。
- ③手で腰ボトムを上げてください。
- ④「背あし連動」か「背のみ」を選び、つまんだレバーが止まるまで倒します。

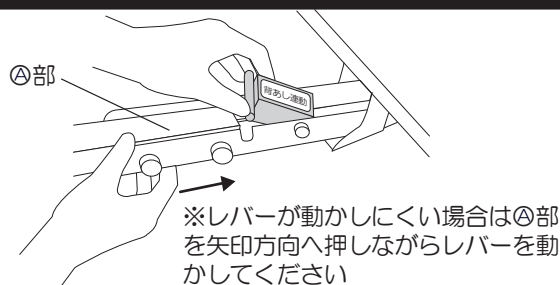

背あし連動

レバー操作で切り替えができます。

背のみ

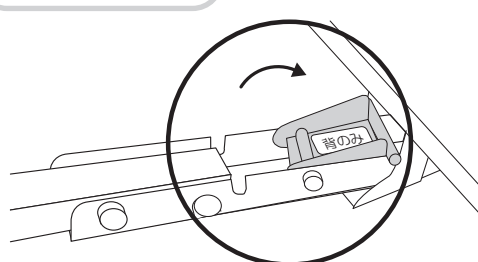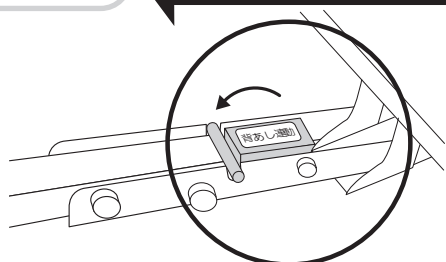

- ⑤腰ボトムを戻し、電源コードを挿してください。
- ⑥手元スイッチを操作し、正しく切り替えられたか確認してください。



フィッティングバーの設定

フィッティングの目的

利用者のひざの位置に合わせて、ひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節することができるため、ベッド上でのズレを軽減します


フィッティングバーの調節方法

①両側のフィッティングバーのピンそれぞれ2本を上を外します。

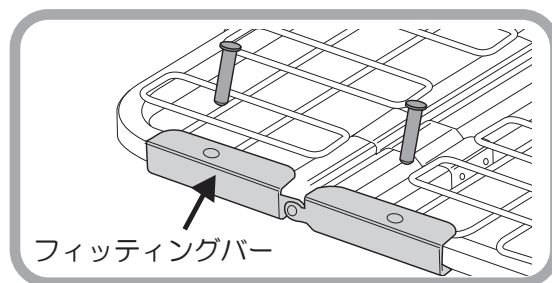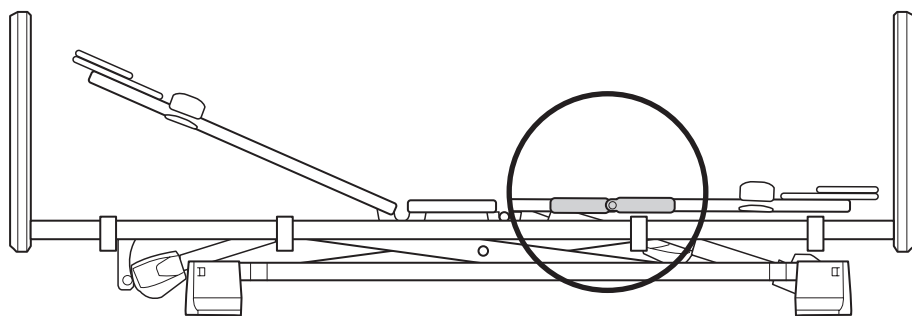


※フィッティングバーの間接部を下図の位置に合わせてください。



② A 位置、B 位置のいずれかを選び、フィッティングバーをスライドさせて穴位置を合わせます。

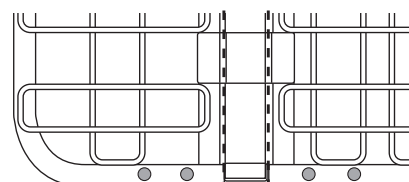



③それぞれ2箇所ピンを挿入します。

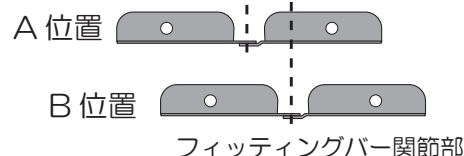

A 位置：適応身長目安約 175 cm未満

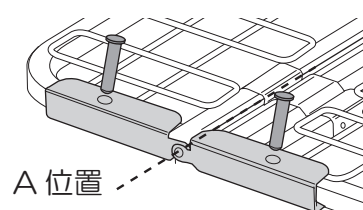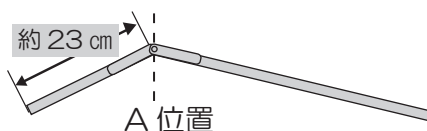

B 位置：適応身長目安約 175 cm以上

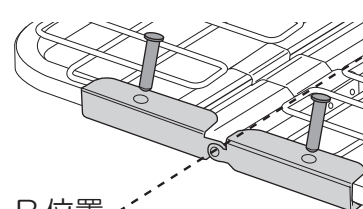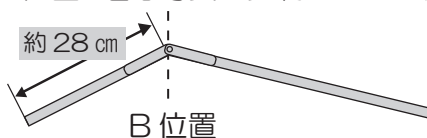

※初期設定は A 位置に合わせています。




確認

両側のピンが同じ位置に挿されているか確認してください

選べるつま先の位置

足のむくみ等の軽減に、“つま先サポートバー”の位置で「足先上げ」「足先下げ」が選べます。


「足先上げ」設定のしかた

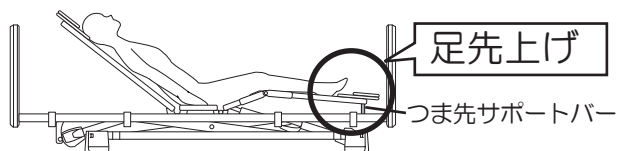


- ① “「足先下げ」設定のしかた”の①図の箇所の脚ボトムネットの隙間から、つま先サポートバーをしっかり押さえて、脚ボトム裏から外します。

- ②つま先サポートバーがフットフレーム溝に入ったことを確認してください。


- ③このままひざ上げします。



「足先下げ」設定のしかた

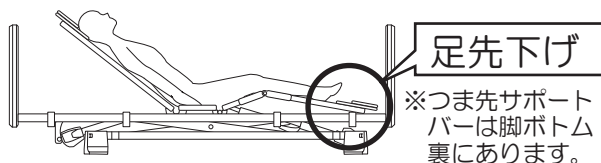


- ①脚ボトムのネット上から、つま先サポートバーを掴むようにして脚ボトム裏にしっかりとめ込みます。

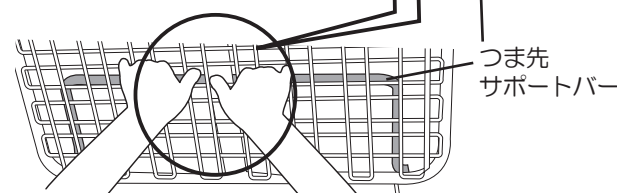

- ②このままひざ上げします。


手元スイッチ

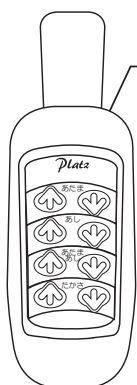

レールのパイプ径に合わせた手元スイッチ裏側の2つの土台でサイドレールに引っ掛けることができます。


- ・土台のみの引っ掛け

- ・フックと2つの土台を引っ掛けることでレール上をスライドできます。

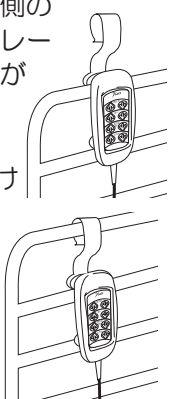


サイドレールホルダーはすべて収納式

車椅子をベッドに密着させることが可能なので、移乗を楽に行うことができます。

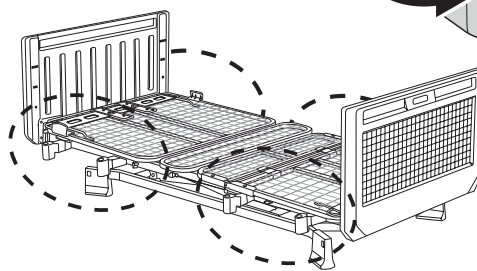


樹脂ボード

樹脂ボード内側の印に合わせて背上げの簡易確認ができます。

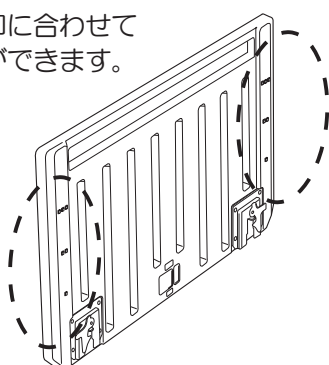

ベースフレーム

ベースフレームのローラーの位置を表示に合わせることで高さの位置確認ができます。

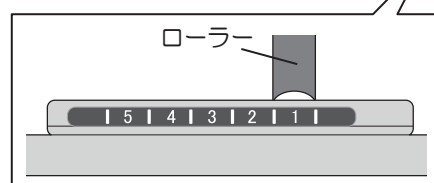

お手入れ・点検・マットレス・部品パックの取り付け位置について

ベッド本体について

○お手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
*著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
*商品を手で濡らしたり、ベンジン・シンナー・
オイル類・粉末洗剤などで磨いたりしないでください。
殺虫剤をかけたりしないでください。
故障・ひび割れ・さびや感電、火災の危険があります。
- ベッドの下を掃除される際は電源プラグを抜いてください。
- ベッドを踏み台代わりに使用しないでください。
- ベッドの下は非常に埃が溜まりやすくなっています。こまめにお掃除してください。
- 電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除してください。
掃除される際は電源プラグを抜いてください。
また掃除後はモーター、手元スイッチコードが接続されているかご確認ください。
- コンセントの根元を樹脂で覆っており発火予防をしておりますが
埃がたまらないようこまめにお掃除してください。




○点検：定期的に行なってください

- 点検前に電源プラグを抜いてください。
- 各部分のビス・ボルト・ナットが緩んでいませんか？
- ボードなどにガタツキがありませんか？
- 電動モーター、手元スイッチコードが正常に装着されていますか？
- コード類にキズ等がありませんか？
- 誤作動、異音がありませんか？

マットレスについて



○マットレスを清潔にご使用いただくために。

- ・定期的に通気や換気を行ってください。
 - ・定期的に日陰干しをしてください。
 - ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。
- ※「日陰干し」→「掃除機でのマットレス全面の吸引」→「日陰干し」を行っていただくより効果的です。

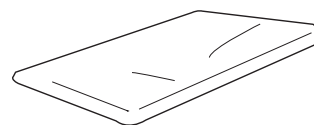

部品パックの取り付け位置について

○組み立て後に部品パックをベッドに取り付ける場合は、ヘッドフレームの右図の場所に取り付けてください。

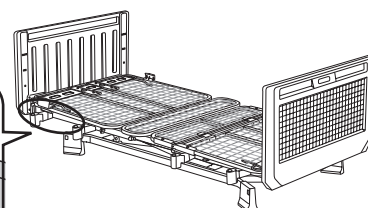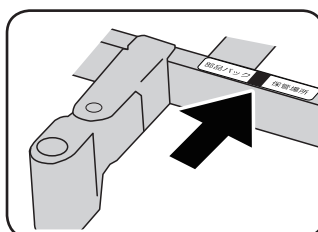


背上げ 1 モーターから 2 モーターへ

背上げ 1 モーター (P113-1 シリーズ) から
2 モーター (P113-2 シリーズ) への変更

交換が必要なもの：

- ◆ベースフレーム (昇降モーター付) 1/5
- ◆センターフレーム (2 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、ベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5
・センターフレーム (背上げ 1 モーター) 2/5 を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してベースフレーム (昇降モーター付) 1/5・センター
フレーム (2 モーター) 2/5 を取り付けて組み立てます。

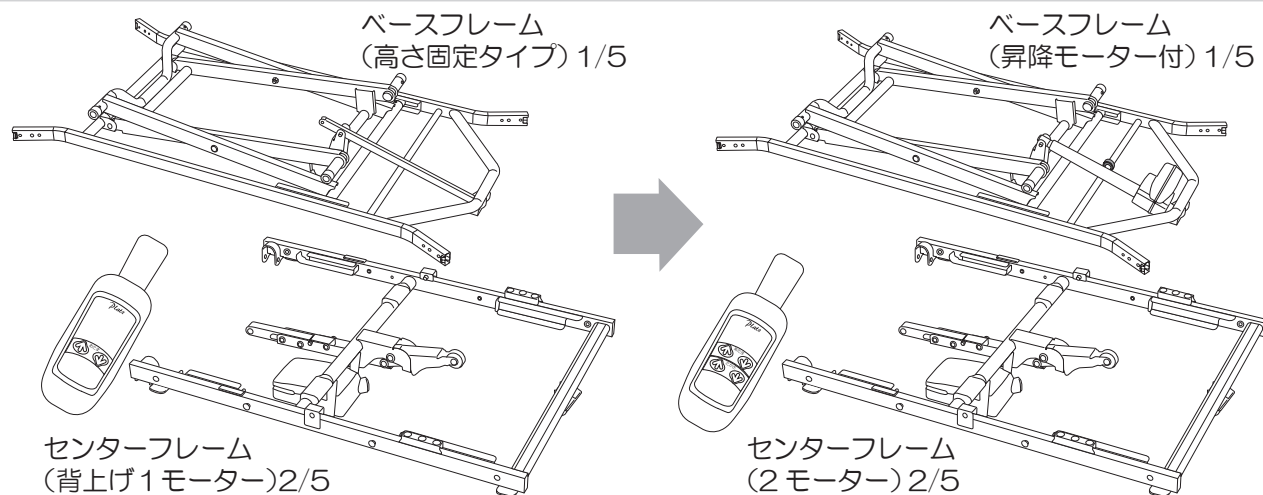


背上げ 1 モーターから 3 モーターへ

背上げ 1 モーター (P113-1 シリーズ) から
3 モーター (P113-3 シリーズ) への変更

交換が必要なもの：

- ◆ベースフレーム (昇降モーター付) 1/5
- ◆センターフレーム (3 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、ベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5
・センターフレーム (背上げ 1 モーター) 2/5 を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してベースフレーム (昇降モーター付) 1/5・センター
フレーム (3 モーター) 2/5 を取り付けて組み立てます。

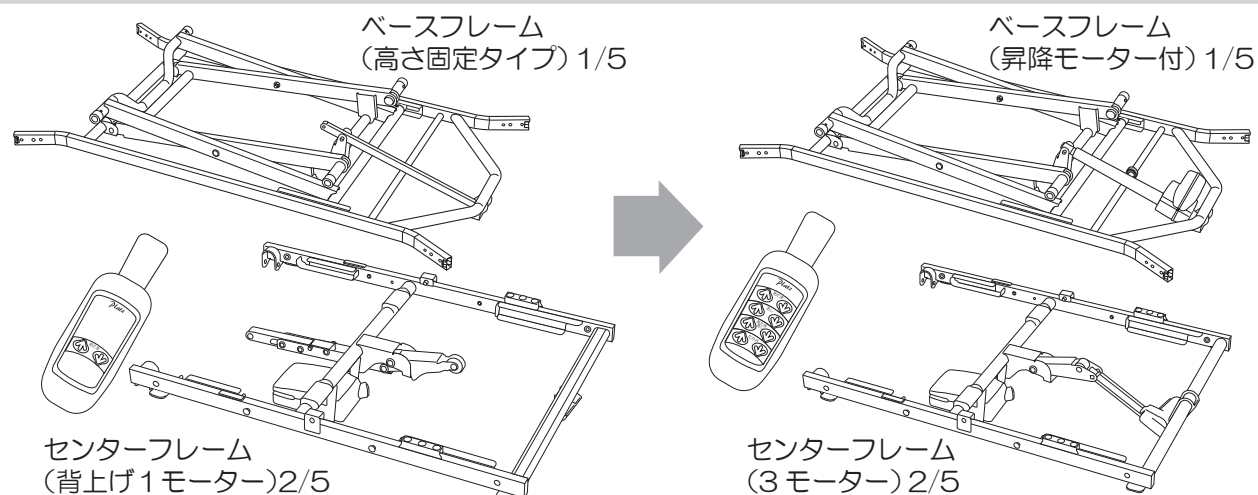


2 モーターから背上げ 1 モーターへ

2 モーター (P113-2 シリーズ) から
背上げ 1 モーター (P113-1 シリーズ)
への変更

交換が必要なもの：

- ◆ベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5
- ◆センターフレーム (背上げ 1 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、ベースフレーム (昇降モーター付) 1/5
・センターフレーム (2 モーター) 2/5 を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5・センター
フレーム (背上げ 1 モーター) 2/5 を取り付けて組み立てます。

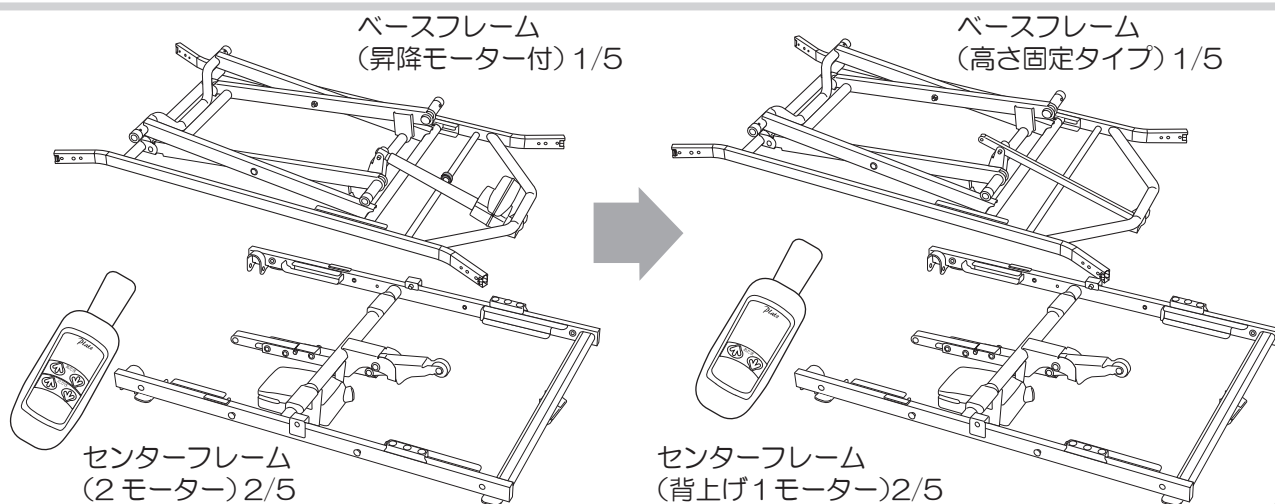

2 モーターから 3 モーターへ


2 モーター (P113-2 シリーズ) から
3 モーター (P113-3 シリーズ) への変更

交換が必要なもの：

- ◆センターフレーム (3 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、センターフレーム (2 モーター) 2/5
を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してセンターフレーム (3 モーター) 2/5 を取り付けて
組み立てます。

※ 2 モーターから 3 モーターの交換キットもございます。交換キットの交換方法は、交換キットの
取扱説明書をご覧ください。

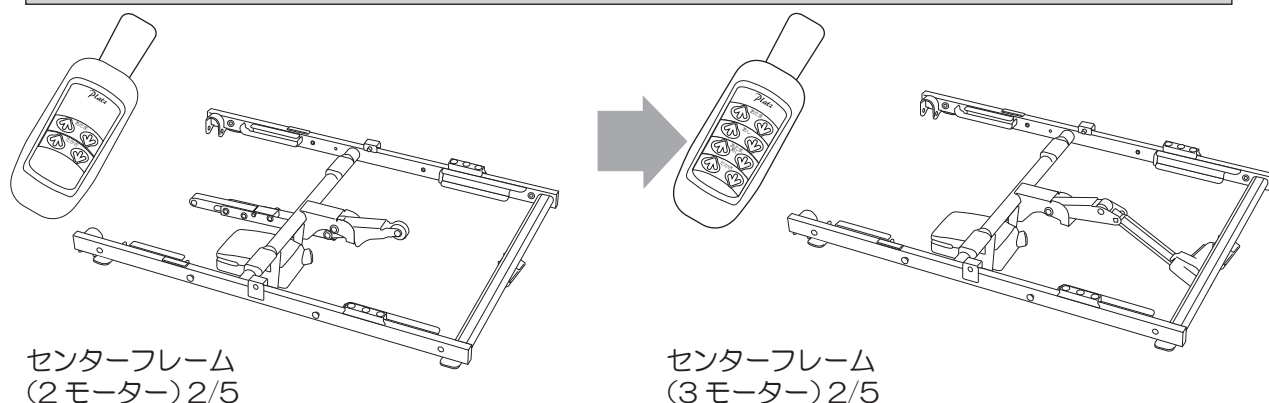

3 モーターから背上げ 1 モーターへ


3 モーター (P113-3 シリーズ) から
背上げ 1 モーター (P113-1 シリーズ)
への変更

交換が必要なもの：

◆ベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5

◆センターフレーム (背上げ 1 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、ベースフレーム (昇降モーター付) 1/5
・センターフレーム (3 モーター) 2/5 を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してベースフレーム (高さ固定タイプ) 1/5・センター
フレーム (背上げ 1 モーター) 2/5 を取り付けて組み立てます。

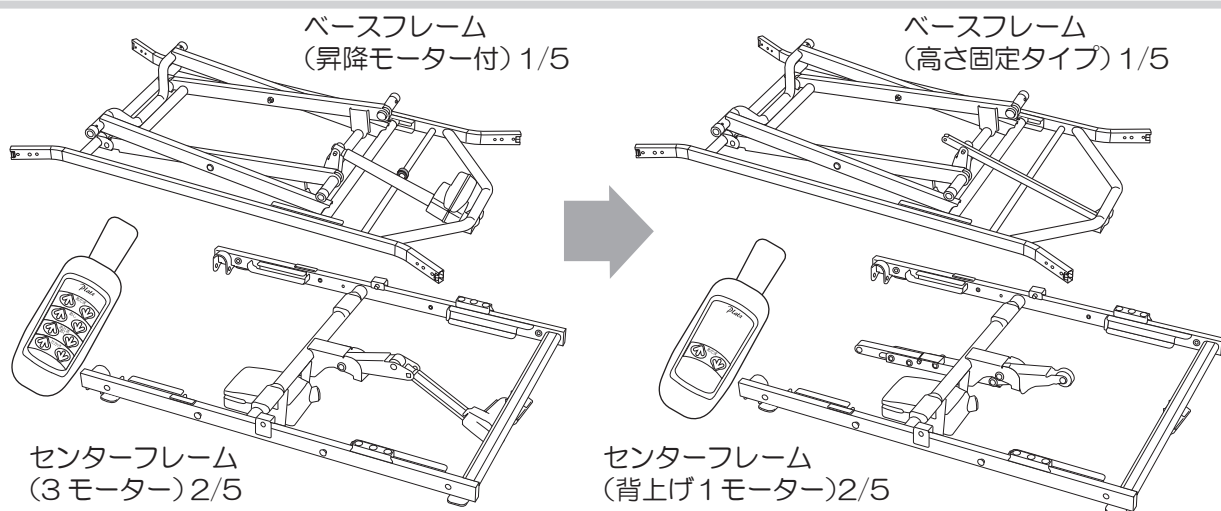


3 モーターから 2 モーターへ

3 モーター (P113-3 シリーズ) から
2 モーター (P113-2 シリーズ) への変更

交換が必要なもの：

◆センターフレーム (2 モーター) 2/5

- ①「組み立てかた」のページを参照し逆の手順で、センターフレーム (3 モーター) 2/5
を取り外します。
- ②「組み立てかた」のページを参照してセンターフレーム (2 モーター) 2/5 を取り付けて
組み立てます。

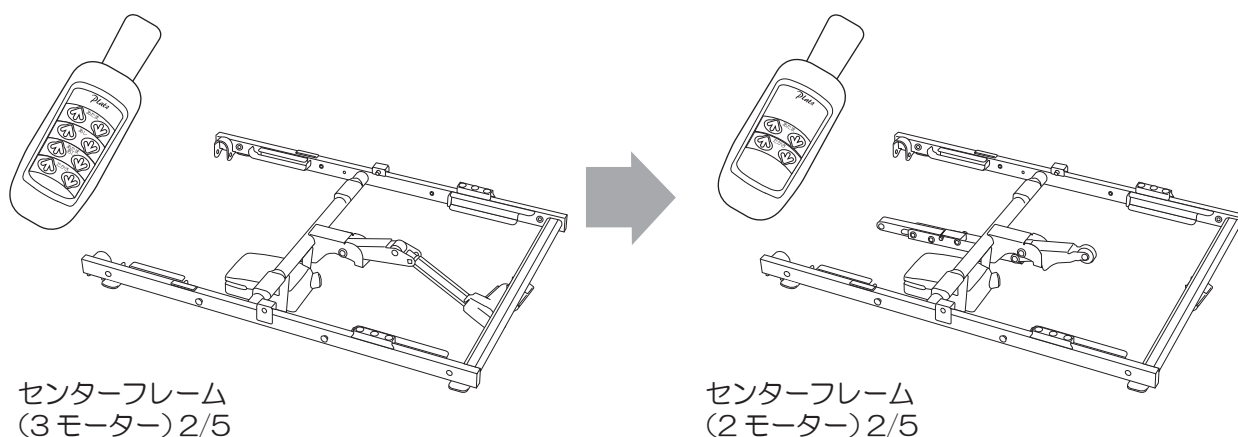

型 式	P113-11 シリーズ		
商品名	背上げ 1 モーターベッド<90 cm幅>		
ベッド寸法	長さ：※ 1 (204.0) 【194.0】『218.0』 ※ 2 (202.0) 【192.0】『216.0』 ※ 3 (217.0) 【207.0】『231.0』 (単位：cm) 床から ボード上端 ：68.5～ 102.5 ボトム上面 から ボード上端 ：43.5 背部の 最大傾斜 角度 70° 幅 100.0 ひざ部の 最大傾斜 角度 22° ボード幅：93.0 ボトム高さ 25.0/31.0（手動） 脚座間 138.0 ボトム上面から ボード上端： ※ 1 (43.5) ※ 2 (29.0) ※ 3 (29.0) ※ 1：樹脂ボード ※ 2：木ヘッドボード、フットボード ※ 3：木宮ヘッドボード、フットボード （ ）：各レギュラーの寸法 【 】：各ショート寸法の寸法 『 』：各ロングの寸法 ★上記記載のないものは共通		
商品質量	(1/5)：ベースフレーム：22.0 kg (2/5)：センターフレーム：9.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：19.5 kg (4/5)：ボトムセット：21.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット：12.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：14.0 kg (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ)：12.0 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。：6.0 kg 商品質量合計 P113-11AC：84.0 kg P113-11BA：86.0 kg P113-11BB：90.0 kg		
梱包サイズ 梱包質量	(1/5)：ベースフレーム：156.0 cm×88.0 cm×23.0 cm：26.5 kg (2/5)：センターフレーム：102.5 cm×75.5 cm×18.0 cm：11.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：93.5 cm×101.5 cm×26.0 cm：24.5 kg (4/5)：ボトムセット：98.0 cm×97.0 cm×18.0 cm：25.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット：94.0 cm×55.5 cm×10.5 cm：13.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：100.0 cm×61.0 cm×10.5 cm：15.0 kg (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ)：100.0 cm×61.0 cm×22.5 cm：13.5 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。：100.0 cm×46.5 cm×7.5 cm：7.0 kg		
材 質	・本体ユニット：スチール、ABS 樹脂 ・木製ボード：MDF、オレフィン系シート ・樹脂ボード：PE		
電動機能	無段階自在式 背上げ（背ひざ連動 / 背単独）、 背上げ角度（0° ～ 70° ）、ひざ上げ角度（0° ～ 22° ）		
その他の特徴	・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式 ・サイドレールホルダーはすべて収納式		
騒音試験結果	50dB(A)		
定格電圧	100V-240V（50/60Hz）		
定格消費電力	100W		
最大利用者体重	138 kg / 安全動作荷重 174 kg（1700N）		
原産国	ベトナム		


型 式

P113-12 シリーズ

商品名

背上げ 1 モーターベッド<83 cm幅>

ベッド寸法

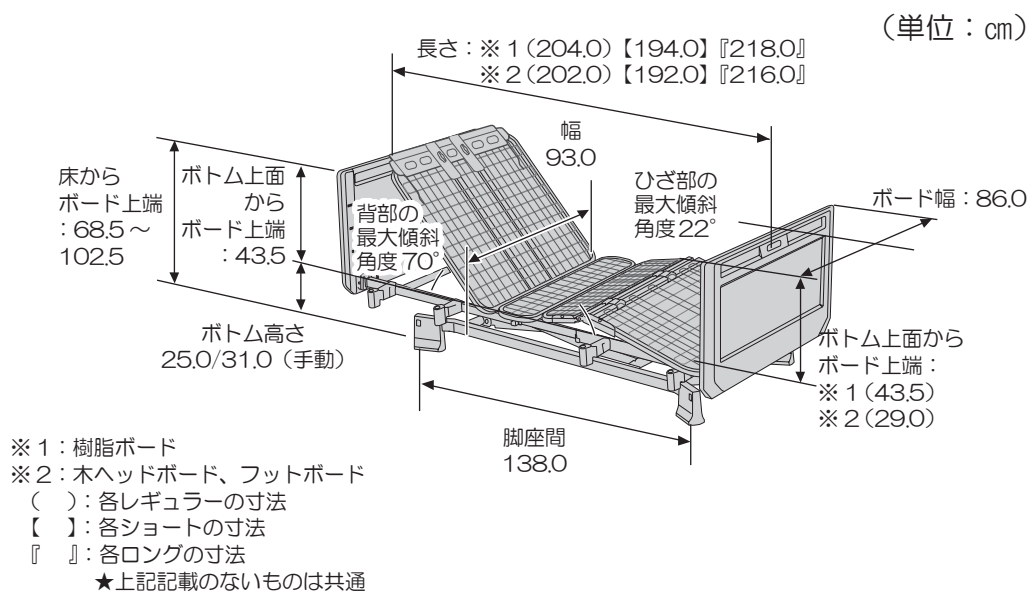

商品質量

(1/5): ベースフレーム	: 22.0 kg	商品質量合計
(2/5): センターフレーム	: 9.5 kg	P113-12CC: 81.5 kg
(3/5): ヘッド・フットフレーム	: 18.0 kg	P113-12DA: 83.0 kg
(4/5): ボトムセット	: 20.5 kg	
(5/5): 樹脂ボードセット	: 11.5 kg	
(5/5): 木製ボードセット(フラットタイプ)	: 13.0 kg	

梱包サイズ
梱包質量

(1/5): ベースフレーム	: 156.0 cm × 88.0 cm × 23.0 cm : 26.5 kg
(2/5): センターフレーム	: 102.5 cm × 75.5 cm × 18.0 cm : 11.5 kg
(3/5): ヘッド・フットフレーム	: 99.5 cm × 101.5 cm × 26.0 cm : 23.0 kg
(4/5): ボトムセット	: 91.0 cm × 97.0 cm × 18.0 cm : 24.5 kg
(5/5): 樹脂ボードセット	: 87.0 cm × 55.5 cm × 10.5 cm : 12.5 kg
(5/5): 木製ボードセット(フラットタイプ)	: 93.0 cm × 61.0 cm × 10.5 cm : 14.0 kg

材 質

- ・本体ユニット: スチール、ABS 樹脂
- ・木製ボード: MDF、オレフィン系シート
- ・樹脂ボード: PE

電動機能

無段階自在式 背上げ(背ひざ連動 / 背単独)、
背上げ角度 (0° ~ 70°)、ひざ上げ角度 (0° ~ 22°)

その他の特徴

- ・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式
- ・サイドレールホルダーはすべて収納式

騒音試験結果

50dB (A)

定格電圧

100V-240V (50/60Hz)

定格消費電力


100W


最大利用者体重

138 kg / 安全動作荷重 174 kg (1700N)

原産国

ベトナム

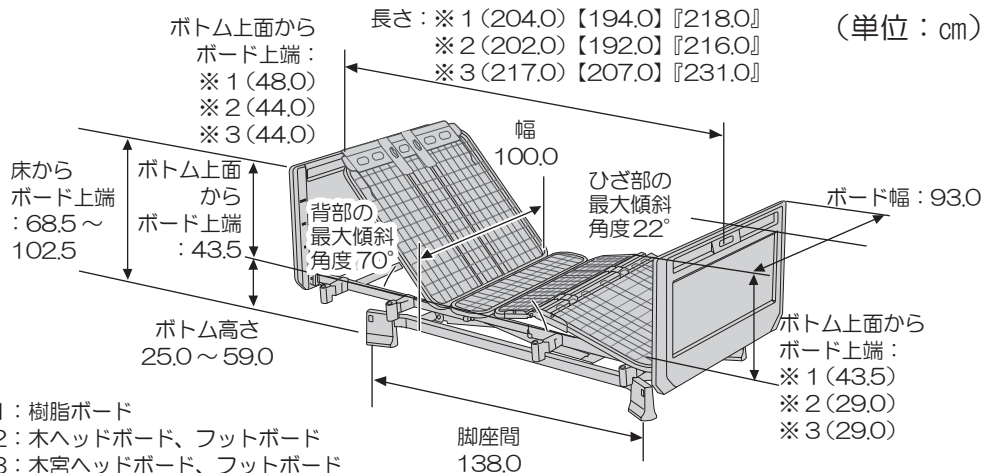型 式	P113-21 シリーズ		
商品名	2 モーターベッド <90 cm幅>		
ベッド寸法	 (単位：cm) 長さ：※1 (204.0) 【194.0】 『218.0』 ※2 (202.0) 【192.0】 『216.0』 ※3 (217.0) 【207.0】 『231.0』 幅 100.0 ひざ部の最大傾斜角度 22° ボード幅：93.0 ボード上端から ※1 (43.5) ※2 (29.0) ※3 (29.0) ボトム高さ 25.0 ~ 59.0 脚座間 138.0 ボトム上面から ボード上端： ※1 (48.0) ※2 (44.0) ※3 (44.0) 床から ボード上端： 68.5 ~ 102.5 ボトム上面から ボード上端： 43.5 背部の最大傾斜角度 70° ※1：樹脂ボード ※2：木ヘッドボード、フットボード ※3：木宮ヘッドボード、フットボード （ ）：各レギュラーの寸法 【 】：各ショートの寸法 『 』：各ロングの寸法 ★上記記載のないものは共通		
商品質量	(1/5)：ベースフレーム : 23.5 kg (2/5)：センターフレーム : 9.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム : 19.5 kg (4/5)：ボトムセット : 21.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット : 12.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ) : 14.0 kg (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ) : 12.0 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。 : 6.0 kg	商品質量合計	P113-21AC : 85.5 kg P113-21BA : 87.5 kg P113-21BB : 91.5 kg
梱包サイズ 梱包質量	(1/5)：ベースフレーム : 156.0 cm × 88.0 cm × 23.0 cm : 28.0 kg (2/5)：センターフレーム : 102.5 cm × 75.5 cm × 18.0 cm : 11.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム : 93.5 cm × 101.5 cm × 26.0 cm : 24.5 kg (4/5)：ボトムセット : 98.0 cm × 97.0 cm × 18.0 cm : 25.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット : 94.0 cm × 55.5 cm × 10.5 cm : 13.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ) : 100.0 cm × 61.0 cm × 10.5 cm : 15.0 kg (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ) : 100.0 cm × 61.0 cm × 22.5 cm : 13.5 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。 : 100.0 cm × 46.5 cm × 7.5 cm : 7.0 kg		
材 質	・本体ユニット：スチール、ABS 樹脂 ・木製ボード：MDF、オレフィン系シート ・樹脂ボード：PE		
電動機能	無段階自在式 背上げ角度 (0° ~ 70°)、ひざ上げ角度 (0° ~ 22°) 昇降 (床面高さ 25 ~ 59 cm)		
その他の特徴	・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式 ・サイドレールホルダーはすべて収納式		
騒音試験結果	50dB (A)		
定格電圧	100V-240V (50/60Hz)		
定格消費電力	150W		
最大利用者体重	138 kg / 安全動作荷重 174 kg (1700N)		
原産国	ベトナム		

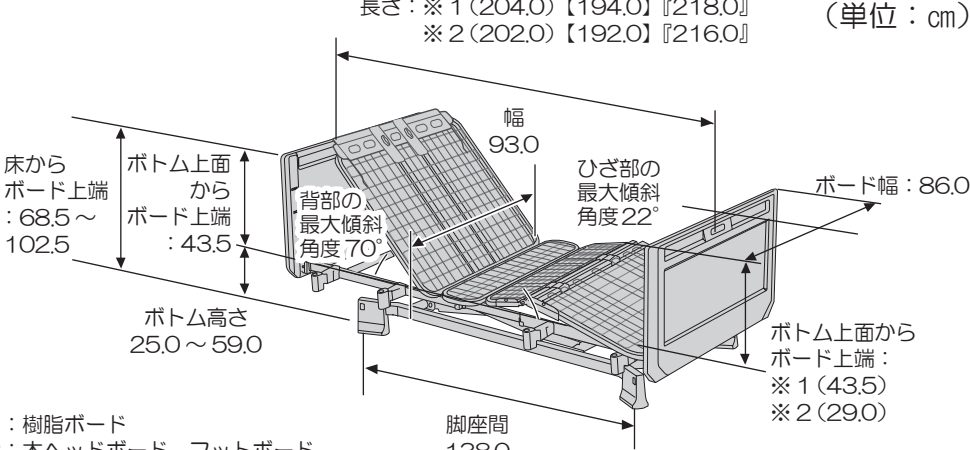型 式	P113-22 シリーズ		
商品名	2 モーターベッド <83 cm幅>		
ベッド寸法	長さ：※1 (204.0) 【194.0】 『218.0』 ※2 (202.0) 【192.0】 『216.0』 (単位：cm)  ※1：樹脂ボード ※2：木ヘッドボード、フットボード ()：各レギュラーの寸法 【 】：各ショート寸法の寸法 『 』：各ロングの寸法 ★上記記載のないものは共通		
商品質量	(1/5)：ベースフレーム：23.5 kg (2/5)：センターフレーム：9.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：18.0 kg (4/5)：ボトムセット：20.5 kg (5/5)：樹脂ボードセット：11.5 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：13.0 kg	商品質量合計 P113-22CC：83.0 kg P113-22DA：84.5 kg	
梱包サイズ 梱包質量	(1/5)：ベースフレーム：156.0 cm×88.0 cm×23.0 cm：28.0 kg (2/5)：センターフレーム：102.5 cm×75.5 cm×18.0 cm：11.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：99.5 cm×101.5 cm×26.0 cm：23.0 kg (4/5)：ボトムセット：91.0 cm×97.0 cm×18.0 cm：24.5 kg (5/5)：樹脂ボードセット：87.0 cm×55.5 cm×10.5 cm：12.5 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：93.0 cm×61.0 cm×10.5 cm：14.0 kg		
材 質	・本体ユニット：スチール、ABS 樹脂 ・木製ボード：MDF、オレフィン系シート ・樹脂ボード：PE		
電動機能	無段階自在式 背上げ角度 (0° ～ 70°)、ひざ上げ角度 (0° ～ 22°) 昇降 (床面高さ 25 ～ 59 cm)		
その他の特徴	・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式 ・サイドレールホルダーはすべて収納式		
騒音試験結果	50dB (A)		
定格電圧	100V-240V (50/60Hz)		
定格消費電力	150W		
最大利用者体重	138 kg / 安全動作荷重 174 kg (1700N)		
原産国	ベトナム		

型 式	P113-31 シリーズ		
商品名	3 モーターベッド <90 cm幅>		
ベッド寸法	長さ：※ 1 (204.0) 【194.0】 『218.0』 ※ 2 (202.0) 【192.0】 『216.0』 ※ 3 (217.0) 【207.0】 『231.0』 (単位：cm)		
	※ 1：樹脂ボード ※ 2：木ヘッドボード、フットボード ※ 3：木宮ヘッドボード、フットボード ()：各レギュラーの寸法 【 】：各ショートの寸法 『 』：各ロングの寸法 ★上記記載のないものは共通		
商品質量	(1/5)：ベースフレーム：23.5 kg (2/5)：センターフレーム：10.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：19.5 kg (4/5)：ボトムセット：21.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット：12.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：14.0 kg ----- (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ)：12.0 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。：6.0 kg		
	商品質量合計 P113-31AC：86.5 kg P113-31BA：88.5 kg P113-31BB：92.5 kg		
梱包サイズ 梱包質量	(1/5)：ベースフレーム：156.0 cm×88.0 cm×23.0 cm：28.0 kg (2/5)：センターフレーム：102.5 cm×75.5 cm×18.0 cm：12.5 kg (3/5)：ヘッド・フットフレーム：93.5 cm×101.5 cm×26.0 cm：24.5 kg (4/5)：ボトムセット：98.0 cm×97.0 cm×18.0 cm：25.0 kg (5/5)：樹脂ボードセット：94.0 cm×55.5 cm×10.5 cm：13.0 kg (5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)：100.0 cm×61.0 cm×10.5 cm：15.0 kg ----- (5/5)：木製ボードセット(宮付タイプ)：100.0 cm×61.0 cm×22.5 cm：13.5 kg [2 梱包] ※ヘッドボード、フットボードは別梱包です。：100.0 cm×46.5 cm×7.5 cm：7.0 kg		
	材 質 ・本体ユニット：スチール、ABS 樹脂 ・木製ボード：MDF、オレフィン系シート ・樹脂ボード：PE		
電動機能	無段階自在式 背上げ角度 (0° ～ 70°)、ひざ上げ角度 (0° ～ 18°) 昇降 (床面高さ 25 ～ 59 cm)		
その他の特徴	・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式 ・サイドレールホルダーはすべて収納式		
騒音試験結果	50dB (A)		
定格電圧	100V-240V (50/60Hz)		
定格消費電力	150W		
最大利用者体重	138 kg / 安全動作荷重 174 kg (1700N)		
原産国	ベトナム		


P113-32 シリーズ

型 式

商品名

3 モーターベッド<83 cm幅>

ベッド寸法

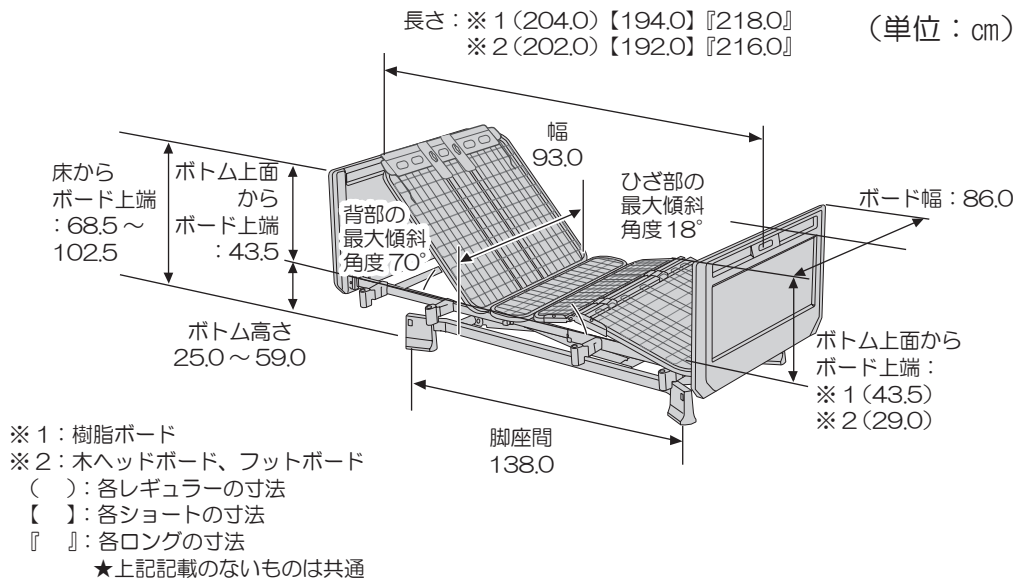

商品質量

(1/5)：ベースフレーム	：23.5 kg	商品質量合計
(2/5)：センターフレーム	：10.5 kg	P113-32CC：84.0 kg
(3/5)：ヘッド・フットフレーム	：18.0 kg	P113-32DA：85.5 kg
(4/5)：ボトムセット	：20.5 kg	
(5/5)：樹脂ボードセット	：11.5 kg	
(5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)	：13.0 kg	

梱包サイズ
梱包質量

(1/5)：ベースフレーム	：156.0 cm×88.0 cm×23.0 cm：28.0 kg
(2/5)：センターフレーム	：102.5 cm×75.5 cm×18.0 cm：12.5 kg
(3/5)：ヘッド・フットフレーム	：99.5 cm×101.5 cm×26.0 cm：23.0 kg
(4/5)：ボトムセット	：91.0 cm×97.0 cm×18.0 cm：24.5 kg
(5/5)：樹脂ボードセット	：87.0 cm×55.5 cm×10.5 cm：12.5 kg
(5/5)：木製ボードセット(フラットタイプ)	：93.0 cm×61.0 cm×10.5 cm：14.0 kg

材 質

- ・本体ユニット：スチール、ABS 樹脂
- ・木製ボード：MDF、オレフィン系シート
- ・樹脂ボード：PE

電動機能

無段階自在式 背上げ角度 (0° ～ 70°)、ひざ上げ角度 (0° ～ 18°)
昇降 (床面高さ 25 ～ 59 cm)

その他の特徴

- ・ボトムは通気性に優れたスチールメッシュ方式
- ・サイドレールホルダーはすべて収納式

騒音試験結果

50dB (A)

定格電圧

100V-240V (50/60Hz)

定格消費電力

150W

最大利用者体重

138 kg / 安全動作荷重 174 kg (1700N)

原産国

ベトナム

3
モーターベッドへ
83
cm幅

仕様について

90 cm幅適合周辺機器

サイドレール	PA505-44/PA505-75/PA505-96/PA500-FU44/ BG-75J/BG-96J
ベッド用グリップ	PF500-116/PZR-AT116J/PG02-116AT/ PG03-116M
ハンドグリップ	PG04-75
ロングタイプ対応 スパーサー	PS02-BG (BG 系用) / PS02-PA505 (PA505 系用) PS03-AT116J (ニーパロ用) / PS03-PF500 (ニーパロⅡ用) / PS03-PG0203(ニーパ+・ニーパロL・ハンドグリップ用)
マットレス	適合マットレス (レギュラータイプ) : PKM-9080/PKM-E80BR/PD503-A9008/ PM09-A9008/PM11-9009/PM12-9009
	適合マットレス (ショートタイプ) : PD504-A9008S/PD503-A9008S/ PM09-A9008S/PM11-9009S/PM12-9009S
	もしくは下記サイズ、質量を満たす物 ◆サイズ: (レギュラータイプ) : 幅 88 ~ 91 cm × 長さ 190 ~ 192 cm (ショートタイプ) : 幅 88 ~ 91 cm × 長さ 182 cm (ロングタイプ) : 幅 88 ~ 91 cm × 長さ 206 cm ◆厚 さ : 最大厚 18 cm以下 最小厚 7 cm以上 ◆質 量 : 34 kg以下
延長マットレス (ロングタイプ用)	PM08-90A、PM08-90B
オーバーテーブル	PGT-400LM
サイドテーブル	PZT-840
床キズ防止 カーペット	PSC-1216SC 床がフローリングなどで滑りやすい材質の場合は、必ず使用 してください。ベッドが滑り怪我の原因となります。
キャスター	PC03-8CK
ハイトスパーサー (固定脚タイプ)	PH05-45

83 cm幅適合周辺機器

サイドレール	PA505-44/PA505-75/PA505-96/PA500-FU44/ BG-75J/BG-96J
ベッド用グリップ	PF500-116/PZR-AT116J/PG02-116AT/ PG03-116M
ハンドグリップ	PG04-75
ロングタイプ対応 スパーサー	PS02-BG (BG 系用) / PS02-PA505 (PA505 系用) PS03-AT116J (ニーパロ用) / PS03-PF500 (ニーパロⅡ用) / PS03-PG0203 (ニーパ+・ニーパロL・ハンドグリップ用)
マットレス	適合マットレス (レギュラータイプ) : PD504-A8308/PD503-A8308/PM09-A8308/ PM11-8309/PM12-8309 適合マットレス (ショートタイプ) : PD504-A8308S/PD503-A8308S/PM09-A8308S/ PM11-8309S/PM12-8309S もしくは下記サイズ、質量を満たす物 ◆サイズ: (レギュラータイプ): 幅 83 cm×長さ 190 ~ 192 cm (ショートタイプ) : 幅 83 cm×長さ 182 cm (ロングタイプ) : 幅 83 cm×長さ 206 cm ◆厚 さ: 最大厚 18 cm以下 最小厚 7 cm以上 ◆質 量: 34 kg以下
延長マットレス (ロングタイプ用)	PM08-83A、PM08-83 B
オーバーテーブル	PGT-400LM83
サイドテーブル	PZT-840
床キズ防止 カーペット	PSC-1216SC 床がフローリングなどで滑りやすい材質の場合は、必ず使用 してください。ベッドが滑り怪我の原因となります。
キャスター	PC03-8CK
ハイトスパーサー (固定脚タイプ)	PH05-45

83
cm
幅

適合周辺機器

パーツ組み合わせ：(90 cm幅)

背上げ1 モーター P113-11 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZNZ-1/5		
センターフレーム	PP113-1AZ-2/5		
ヘッドフレーム・ フットフレーム	PP113-BAZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZAZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-ACZ-5/5		
木製ボード	PP113-BAZ-5/5		
木製宮付ボード	PP113-BBZ-5/5		

2 モーター P113-21 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZHZ-1/5		
センターフレーム	PP113-2AZ-2/5		
ヘッドフレーム・ フットフレーム	PP113-BAZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZAZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-ACZ-5/5		
木製ボード	PP113-BAZ-5/5		
木製宮付ボード	PP113-BBZ-5/5		

3 モーター P113-31 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZHZ-1/5		
センターフレーム	PP113-3AZ-2/5		
ヘッドフレーム・ フットフレーム	PP113-BAZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZAZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-ACZ-5/5		
木製ボード	PP113-BAZ-5/5		
木製宮付ボード	PP113-BBZ-5/5		

90
cm
幅

パ
ー
ツ
組
み
合
わ
せ

パーツ組み合わせ：(83 cm幅)

背上げ1 モーター P113-12 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZNZ-1/5		
センターフレーム	PP113-1AZ-2/5		
ヘッドフレーム・フットフレーム	PP113-BBZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZBZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-CCZ-5/5		
木製ボード	PP113-DAZ-5/5		

2 モーター P113-22 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZHZ-1/5		
センターフレーム	PP113-2AZ-2/5		
ヘッドフレーム・フットフレーム	PP113-BBZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZBZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-CCZ-5/5		
木製ボード	PP113-DAZ-5/5		



3 モーター P113-32 シリーズ	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
ベースフレーム	PP113-ZHZ-1/5		
センターフレーム	PP113-3AZ-2/5		
ヘッドフレーム・フットフレーム	PP113-BBZ-3/5		
ボトムセット	PP113-ZBZ-4/5		
樹脂ボード	PP113-CCZ-5/5		
木製ボード	PP113-DAZ-5/5		

83
cm
幅






パ
ー
ツ
組
み
合
わ
せ

正しい組み合わせ

ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご利用される際の隙間





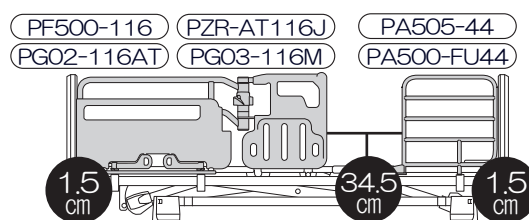
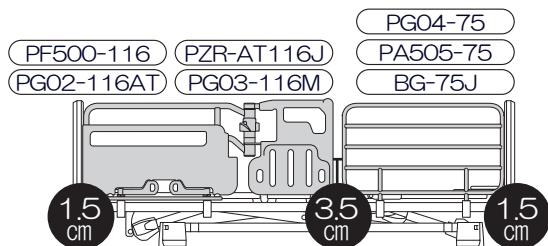


サイドレールとハンドグリップを組み合わせてご利用される際の隙間

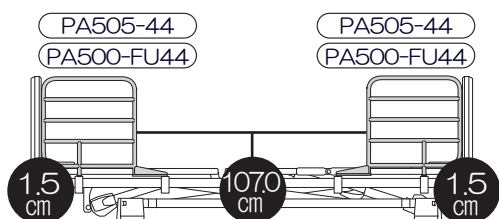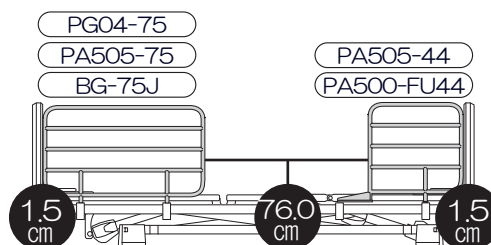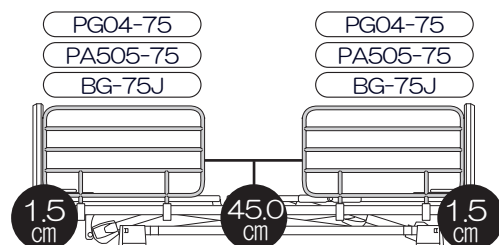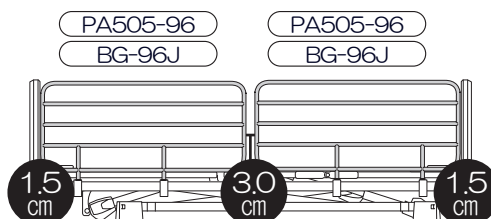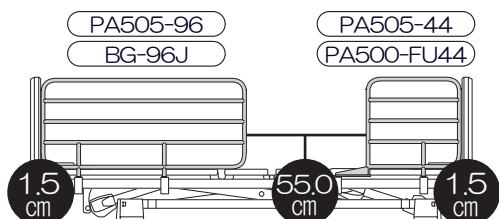



誤った組み合わせ

下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生により怪我をする恐れがあります。

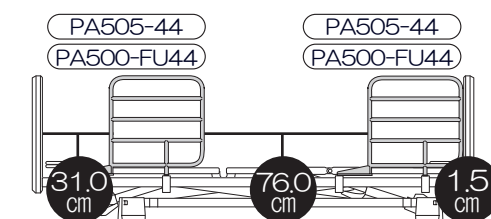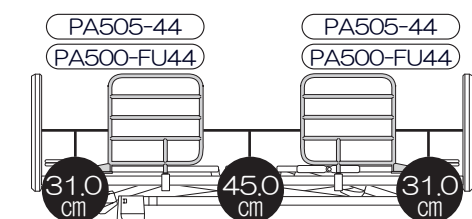
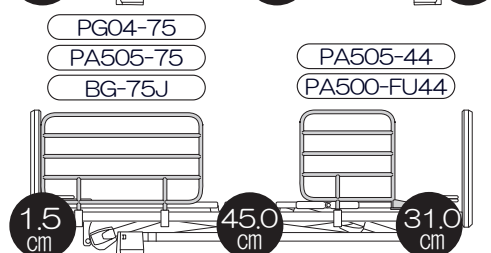
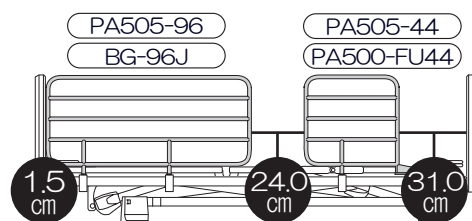
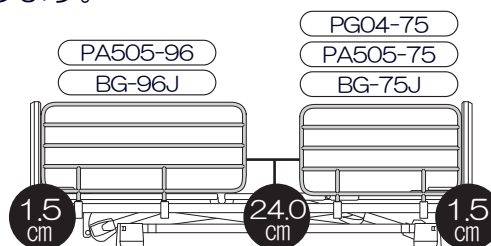
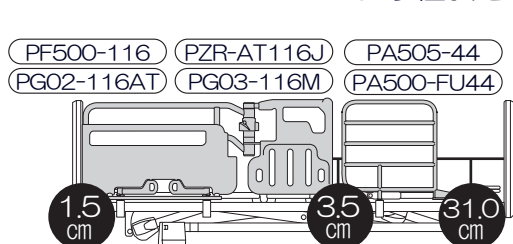


正しい組み合わせ

ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご利用される際の隙間





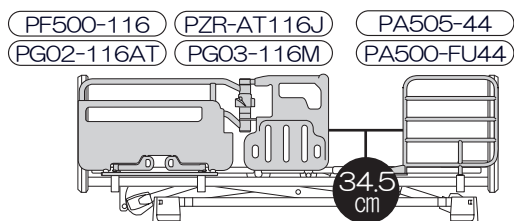
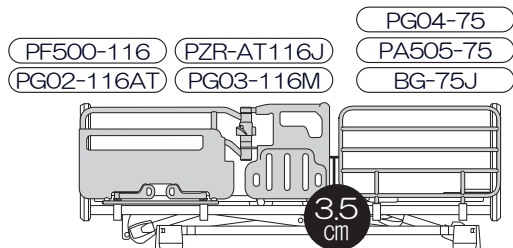


サイドレールとハンドグリップを組み合わせてご利用される際の隙間

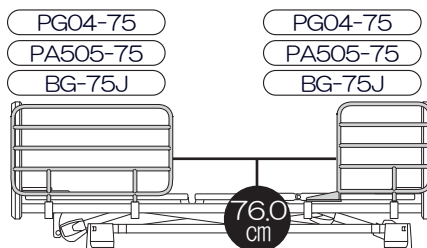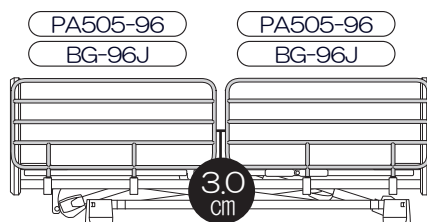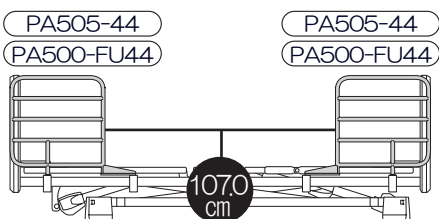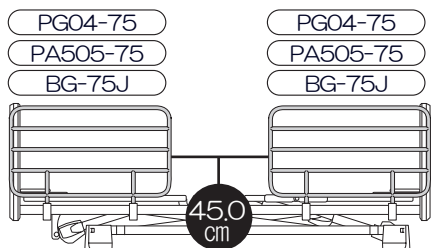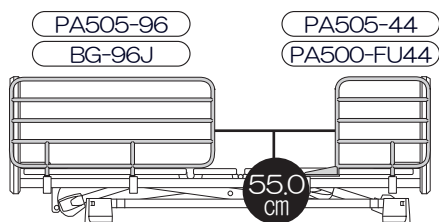

誤った組み合わせ


下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生により怪我をする恐れがあります。

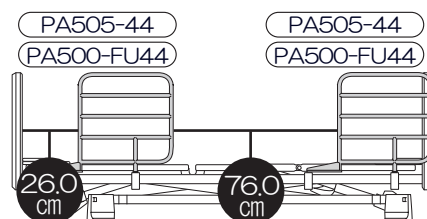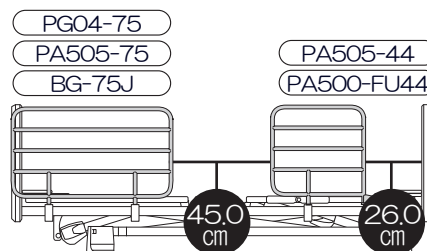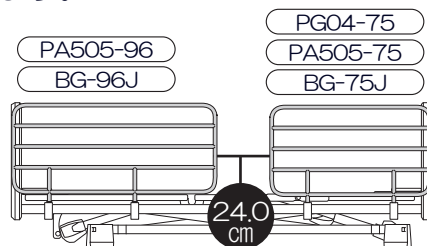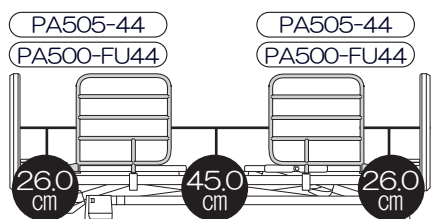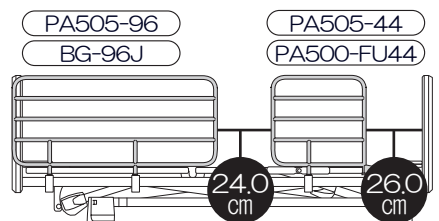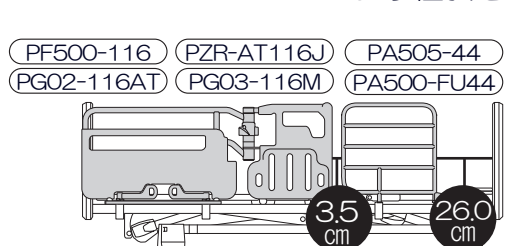


正しい組み合わせ

※必ず「ロングタイプ対応スパーサー」を取り付けてください。

ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご利用される際の隙間

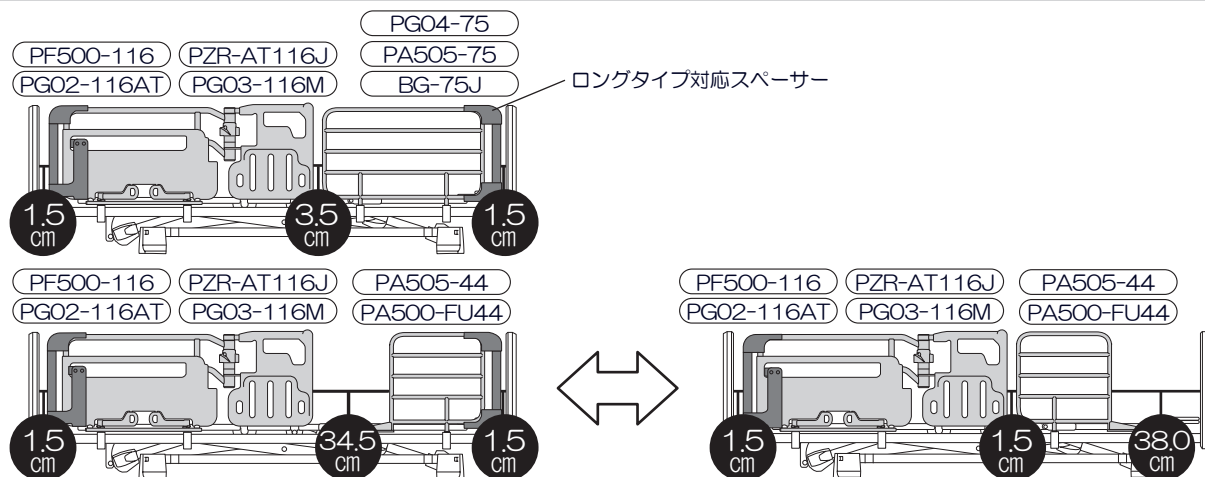


サイドレールとハンドグリップを組み合わせてご利用される際の隙間

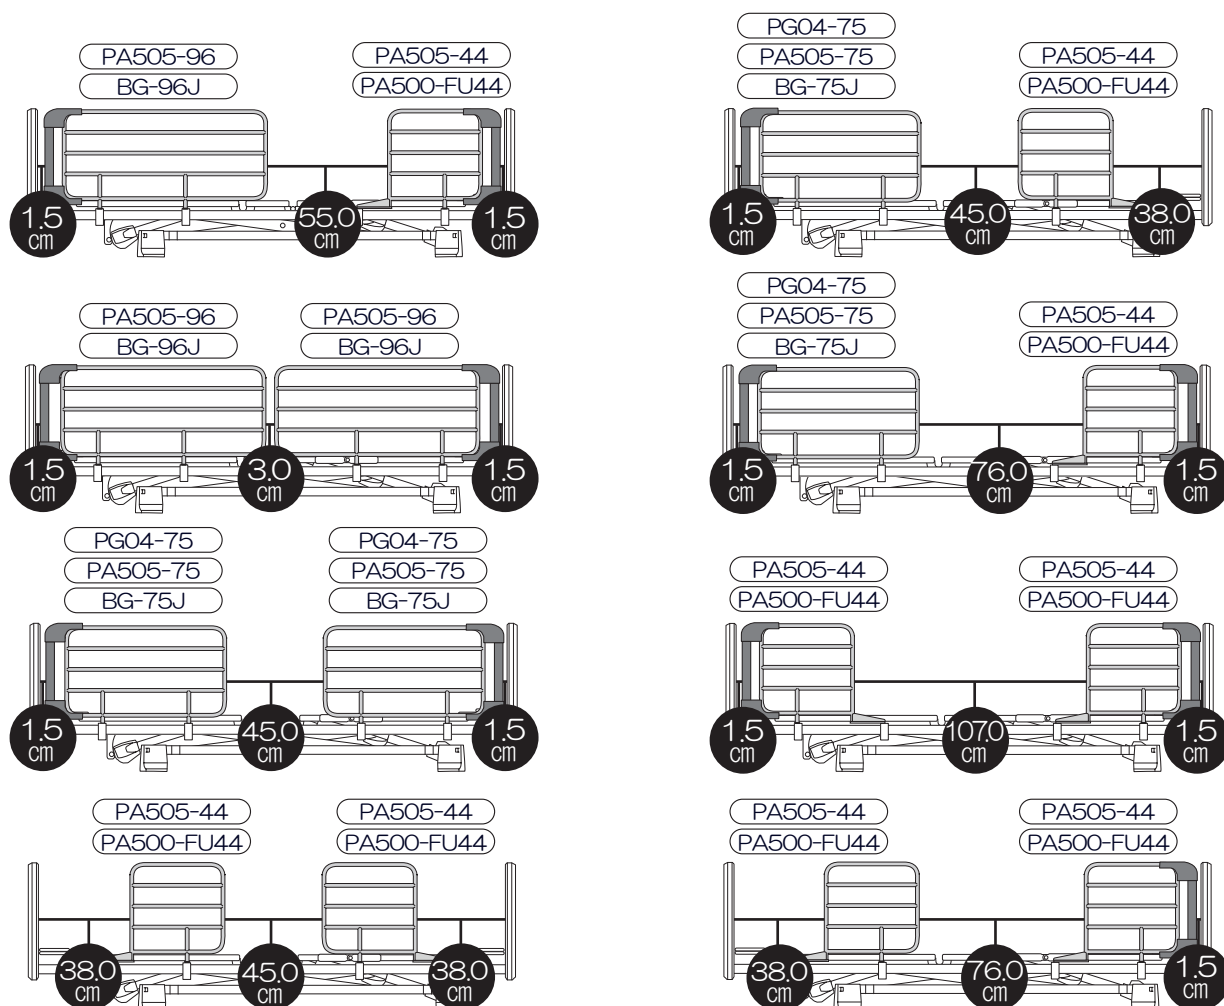

誤った組み合わせ


下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生により怪我をする恐れがあります。

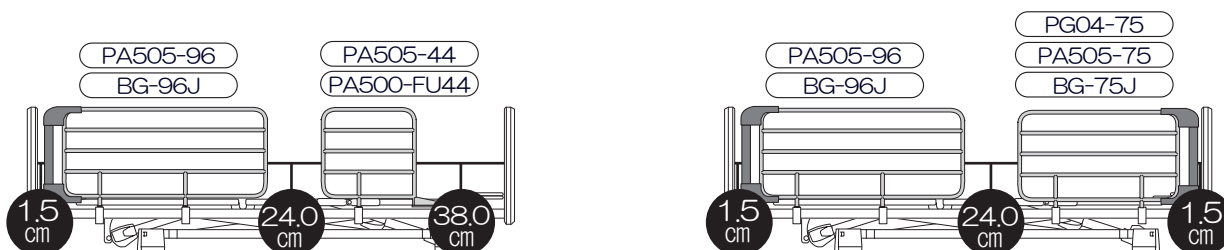

停電時の背下げ操作方法

※作業時は、必ずご利用様はベッドから降りていただき作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。※危険防止のため、作業は2人以上で行ってください。

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

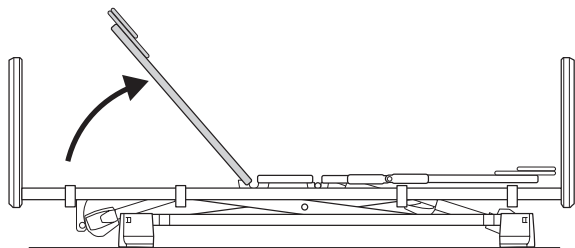


警告

安全のため作業は2人以上で行ってください。

②背上げモーター先端のピンを外してください。


ここを斜めに押しながら、
抜け止めスナップ
ピンを取り外します。

反対側から
ピンを抜きます。

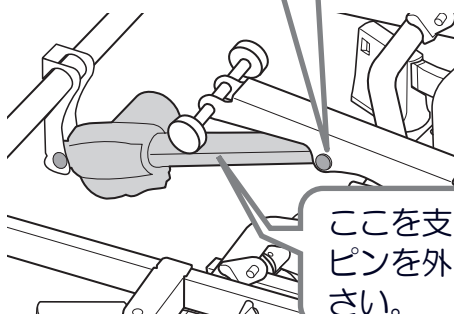


ここを支えながら
ピンを外してください。

③背上げモーター根元側の抜け止めスナップピンとピンを抜いてください。

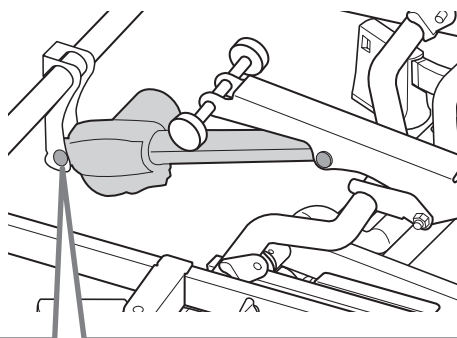



ここを斜めに押しながら、
抜け止めスナップ
ピンを取り外します。

反対側から
ピンを抜きます。

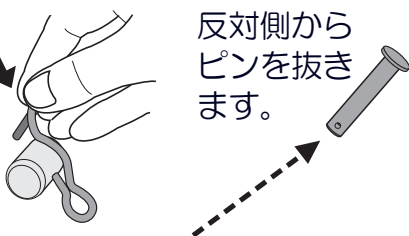

④背上げモーターをヘッドフレームから外します。

⑤背ボトムを下ろします。

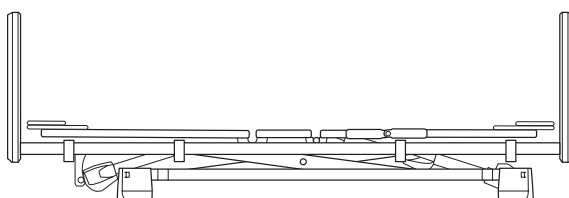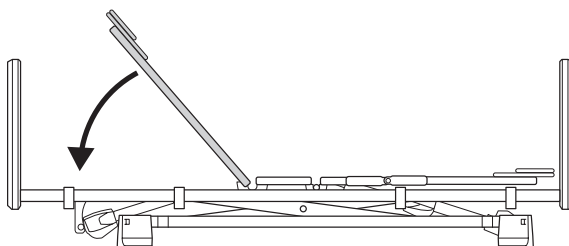

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外した抜け止めスナップピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。
※停電時はオプションのバッテリーを使用して、背下げをおこなうことができます。

故障かな…！？

商品が動かないときは、下記項目を確認してください

症状	確認していただきたいこと	処 置
商品が動かない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込んでください
	延長コードのプラグが抜けていませんか？	延長コードのプラグが抜けていないか、延長コードに故障がないかを必ず確認してください
	電源プラグが破損していませんか？	販売店または弊社にご相談ください
	手元スイッチ、またはモーターのコードが抜けていませんか？	手元スイッチ、およびモーターのコネクタの挿込口に挿し込んでください
	ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？	ブレーカーを確認してください

保管について

長期保管 する場合

長期間ベッドをご使用にならない場合は下記にご注意ください。
 ○高温、多湿、低温、乾燥、ほこりの多い場所を避けて保管してください。
 ○取扱説明書は大切に保管してください。

組み立てた状態 でベッドを保管 する場合

○背ボトム、ひざボトムを水平にしてください。
 ○ベッドの上にはマットレス以外のものを載せないでください。
 ○ベッドを壁に立て掛けたり横倒しにせず、床に水平に置いて保管してください。
 ○電源プラグをコンセントから抜いてください。
 電源コードをはさんだり踏んだりしない場所に保管してください。


分解してベッド を保管する場合

○ベッドの分解は取扱説明書に従って分解してください。
 ○使用を再開する場合は、取扱説明書に従って正しく組み立ててください。

■サービスを依頼される前に、取扱説明書の50ページ「故障かな…!？」の項目にしたがって確認してください。
それでも直らない場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①商品名及び型式（表紙記載）
 - ②お買い上げの販売店
（裏表紙保証書記載）
- ・故障内容（出来るだけ詳しく）
 - ・ご住所 / お名前 / お電話番号
 - ・お買い上げ日

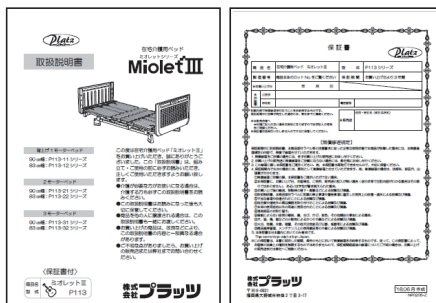

保証期間について

保証期間はお買い上げ日から3年間です。

保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理致します。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を過ぎている場合

修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理致します。

修理代について

修理代は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。

- 部品料…修理で使用した部品代です。
- 基本出張料…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
- 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

プラッツ本社

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17 TEL:092-584-3434



Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal lines.

保証書



商 品 名	在宅介護用ベッド ミオレットⅢ	型 式	P113 シリーズ
製 造 番 号	商品本体のロット No. をご覧ください	保 証 期 間	お買い上げ日より 3 年間
★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご住所		
	お名前	電話番号	

記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合には、弊社までご連絡ください。

※★販売店様へ
★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入の有無
をご確認ください。
※保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

★販売店	住所・会社名（または店名）
------	---------------

【無償修理規定】

保証期間中に取扱説明書、本商品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品が故障した場合には、本無償修理規定の内容で、無償で修理させていただきます。

1. 無償修理をご依頼の場合には、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。
2. お買い上げの販売店に無償修理をご依頼にならない場合には、弊社宛にお申し付けください。
3. この修理に際し本保証書をご提示ください。尚、本保証書は再発行できませんので、大切に保管ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有償修理とさせていただきます。尚、有償修理の場合は、技術料、部品代、出張費がかかります。
 - ①無償修理ご依頼の際、本保証書をご提示いただけない場合。
 - ②本保証書に、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店の記入が無い場合（送り状等で左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - ③お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などによる故障及び損傷。
 - ④取扱説明書、本商品添付ラベルに記載の禁止事項や警告事項に違反した使用上の故意・過失による故障及び損傷。
 - ⑤不当な修理や改造されたことによる故障及び損傷。
 - ⑥他社製や指定外の周辺機器を取り付けたことによる故障及び損傷。
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用されたことによる故障及び損傷。
 - ⑧消耗部品のお取り替え。
 - ⑨瑕疵によらない自然の磨耗、傷、さび、かび、変色、その他類似の事由による場合。
 - ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物によるかじりや糞などによる故障及び損傷。
 - ⑪火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害等による故障及び損傷。
 - ⑫商品維持管理、メンテナンス上の使用薬品等の不備による故障及び損傷。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

'18.09 月 作成

NP0205-Z